

REPUBLIKA E KOSOVES • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
 KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ

DREJTORIA E ADMINISTRATES DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACUE I OSOBLJA

Datë / Izlaze: Date / Dana: 01 / 10 / 2025

Nr. Orgv Org. red	OK	Nr. Prot. Br. Prot.	102	Nr. Faqe Br. Strana	22
----------------------	----	------------------------	-----	------------------------	----

Ferizaj - Uroševac



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
 KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ

<https://ferizaj.rks-gov.net/>



ZYRA E PROKURIMIT
 KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
 PROCUREMENT OFFICE

Tel.: 038 200 46 045
 E-mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
 Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË /Furnizime/

TITULLI I KONTRATËS:

**Rregullimi i kabineteve profesionale dhe paisja me mjete
 laboratorike shkollore.**

NUMRI I PROKURIMIT: 656-25-7245-1-1-1

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

Komuna e Ferizajt, Zyra e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë të cilën e përfaqëson, znj. Arbërie Bektashi – Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit dhe në anën tjetër:

Grupi i Operatorëve Ekonomik: NT "Rilindja Commerc" & "INFINITT" SH.P.K, nga Ferizaj, me NUI – 810637522, e përfaqësuar nga z. Osman Berisha (në vazhdim "Kryesi i furnizimeve"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike kornize për:

Titulli i Kontratës Publike Kornizë: "Rregullimi i kabineteve profesionale dhe paisja me mjete laboratorike shkollore"

Nr. i prokurimit	565-25-7245-1-1-1
-------------------------	--------------------------

Neni 1 Lënda:

1.1 Lënda e kontratës publike kornizë është të krijoj kushtet dhe rregullat e implementimit për kryerjen e furnizimeve (shih Aneksin 1 për përshkrimin e këtyre produkteve dhe sasi të parashikuar që mund të dorëzohen gjatë kohëzgjatjes së kontratës publike kornizë).

Komuna Ferizaj bënë blerjen në emër të specifikuar në Aneksin 7.

Përdorimi i kësaj Kontrate Publike Kornizë është obliguese për të gjitha Autoritetet Kontraktuese të specifikuar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.

1.2 Kjo kontratë publike kornizë do të implementohet nga data e nënshkrimit

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative dhe Autoritetet Kontraktuese të specifikuar në Aneksin 7 me të drejtë të tij mund të kërkojnë furnizim më pak ose më shumë sasi se sa ato sasi të vlerësuara.

1.4 Nënshkrimi i kontratës publike kornizë nuk imponon obligim mbi asnjërin Autoritetet Kontraktues të identifikuar në Aneksin 7 për të blerë sasi të parapara në Aneksin 1. Kryesi i Furnizimeve nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do të lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktues vendosë të kërkojë furnizimet e parapara të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktues vendos të MOS regjistrojë ASNJË nga këto sasira për disa artikuj.

1.5 Zbatimi i kësaj kontrate kornizë do të fillojë me nënshkrim nga të dyja palët. Kjo kontratë kornizë ka kohëzgjatje prej **(36) Tridhjetë e gjashtë muaj**.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë pas nënshkrimit të kontratës dhe deri më **29.09.2028** duhet të kryhet në tërësi furnizimi.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë sipas kërkesës.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë

Neni 4 Çmimi

4.1 Vlera e kontratës kornizë për është: **417,577.20 € (Katërqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e shtatë euro e njëzet cent)** në kohëzgjatje prej **36 muaj**. Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative është +/- **30%**.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i kryesit të Furnizimeve duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Aneksi nr. 1 - Specifikat teknike të Detyrueshme
- (g) Aneksi nr. 7 - Lista e Autoriteteve Kontraktuese
- (h) Urdhër blerjet

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet cilitdo Autoritet Kontraktues të specifikuar në Aneksin 7, nga njëra anë dhe kryesit të furnizimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Në të gjitha këto komunikime Komuna Ferizaj duhet të njoftohet (Cc-ed) në mënyrë që të përcjell zbatimin e kontratës.



6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi

duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shënohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

Për kryesin e furnizimeve:
NT "Rilindja Commerc" &
"INFINITT" SH.P.K

Për Autoritetin Kontraktues
Zyra e Prokurimit
Komuna Ferizaj

Emri:	z.Osman Berisha	Emri:	znj.Arbërie Bekteshi
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	01.10.2025	Data:	01.10.2025
Vula:		Vula:	

Emri dhe Mbiemri	z. Agim Aliu
Pozita:	Kryetar i Komunës
Nënshkrimi:	
Data:	01.10.2025
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14

Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15

Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumatat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkeljet të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16

Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të

dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17

Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të testit te Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet

e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohej se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paaautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizuesi do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizuesi mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo

keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20

Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimi, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhrë, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhet ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i

pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21

Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërës nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkojnë në kontratë.

Neni 22

Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkojnë ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet,

autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga

Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të

certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	Në bazë të LPP-së Ligji me nr. 04/L-042 neni 26 pika 1,
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	8.1	Kryesi i furnizimit, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, do të dorëzoj tek Zyra e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në shumë prej: 41,757.72 € (Dyzet e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë euro e shtatëdhjetë e dy cent) , valide nga një bankë e licencuar ose kompani e licencuar nga BQK-ja. Ky sigurim është valid 37 muaj.
Sigurimi	9.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Cilësia e furnizimeve	16.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materilit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të percaktuara në specifikimin teknik i pranuar.
Inspektimi dhe testimi	17.2	Menaxheri i Projektit është: z.Bashkim Bytyçi – zyrtar i lartë për arsimin e mesëm të ulët. Mbikqyres i drejtperdrejt i Menaxherit të Projektit është: znj.Mukadeze Sylejmani – zyrtare financiare në Drejtorinë e Arsimit.
Parimet e përgjithshme të pagesave	18	Pagesa do të bëhet nga Drejtoria e Arsimit, pas përfundimit të çdo furnizimi, kryesi i furnizimit duhet të dorëzoj tek AK një faturë origjinale dhe nga një kopje fletëdërgesës – fletëpranimit për furnizimet e kryera. Të gjitha faturat e dorëzuara duhet të deklarohen në Euro. Çdo faturë duhet të përmbajë informacionet e nevojshme.

		Pagesa do të bëhet sipas furnizimeve nga OE, situacioni i nënshkruar nga Organi Mbikqyrës.
Dorëzimi	19.3	Dërgesa: Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të pakëtohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre.
Obligimet e garancionit	22.1	Shuma e garancionit kryesit të furnizimeve – do të konfiskohet në rast se i njëjti në mënyrë të njëanshme e ndërprente (shkëputë) kontratën ose bënë shkeljen e kontratës.
Shërbimet pas shitjes	23.1	N/A
Verejtje		Në rast të mospërmbushjes së kontratës nga Operatori Ekonomik, në bazë të kushteve të Përgjithshme dhe kushteve të veqanta të kontratës, Autoriteti Kontraktues do të i ndërmarrë të gjitha masat e parapara me ligjin dhe legjislacionin detyrues të prokurimit publik duke konfiskuar sigurimin e ekzekutimit dhe shkëputjen e njëanshme të kontratës. Me vërejten numër rendor 3 dhe rekomandimin nga menaxheri i kontratës, Autoriteti Kontraktues do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme duke shkëputur kontratën njëanshem dhe duke konfiskuar sigurimin e ekzekutimit të tenderit
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues - Komuna Ferizaj.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komerciale në Prishtinë, në pajtim me ligjet në Kosovë.



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria |

10001262403

Për

KOMUNA FERIZAJ

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

NT, „Rilindja Commerc” | & INFINITT SH.P.K

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Rregulimi i kabineteve profesionale dhe paisja me mjete laboratorike shkollore

të dhënë me numrin e Prokurimit

656-25-7245-1-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

41,758.00 €

Katërdhjetë e Një Mije e Shtatë Qind e Pesëdhjetë e Tetë Euro

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju paguimë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

41,758.00 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

01.10.2025

deri më

31.10.2028

Lëshuar në

Prishtinë

datë

01.10.2025

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

Ardian Cakigi

PRISHTINË





REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVA • REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ

<http://kk.rks-gov.net/ferizaj>



ZYRA E PROKURIMIT
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
PROCUREMENT OFFICE

01. Nr. 288/2025

Datë: 01.10.2025

Tel.: 038.200.46.045

E- mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net

Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

Në bazë të nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, si dhe nenit 70 të Rregullores Nr. 002/2024 për Prokurimin Publik, e datës 11.11.2024, Kryetari i Komunës merr:

V E N D I M

PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT TË KONTRATËS DHE MBIKQYRËSIT TË DREJTPËRDREJTË TË MENAXHERIT TË KONTRATËS

1. Emërohet Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Kontratës për kontratën: **“Rregullimi i kabineteve profesionale dhe paisja me mjete laboratorike shkollore”**, me numër të prokurimit: **656-25-7245-1-1-1**
2. Emërohet Menaxher i kontratës: **z.Bashkim Bytyçi** – zyrtar i lartë për arsimin e mesëm të ulët.
3. Emërohet Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës: **znj.Mukadeze Sylejmani** – zyrtare financiare ne drejtorinë e Arsimit.
4. Menaxheri i kontratës, dhe Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratave në pajtim me Rregulloren Nr. 002/2024 për Prokurimin Publik, e datës 11.11.2024, për Prokurimin Publik, si dhe Manualin për Përdorim të Modullit për Menaxhim të Kontratës;
5. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.
I'u dorëzohet:
 1. Menaxherit të Kontratës;
 2. Mbikqyrësit të Menaxherit të Kontratës;
 3. Zyrës së Kryetarit;
 4. Zyrës së Prokurimit.



Kryetar i Komunës

Agim Aliu

I. MUJETET E PUNËS

Nr	Artikulli	Njësia	Sasia	Cmimi per njesi	Cmimi total me TVSH
1	Maniken (kukull-bebe madhesi te ndryshme) Modeli i foshnjës së porsalindur me afat të plotë 1. Demonstrimi i femijës së porsalindur, karakteristikave realiste, madhësisë dhe formës në përputhje me rastin e foshnjës normale me afat të plotë 2. Ky produkt mund të përdoret si dush për femije, ndërrim robash dhe pelena dhe kujdes për këthizën, kujdes për sytë, veshët dhe udhëzimin për trajnimin e infermierisë dhe mjete mësimore. 3. E disponueshme në mësimdhënien klinike të studentëve për operacione të ndryshme, të tilla si ofrimi i mekanizmave të flojt të prodhimit, trajtimi i femijëve të porsalindur, duke përfshirë pikat e syve, dhithjen e mukusit dhe larjen e femijës së porsalindur, barkun e kordonit të këthizës dhe nëse është i pajisur me kordonin e këthizës mund të jetë Tubi i lekurës për futjen e kord	Copë	4	980.00	3,920.00
2	Krahë maniken (venoze) Modeli i plote funksional i injektimit të venipunkturës së krahut Karakteristikat 1. Injeksion simulates, transfuzion gjaku, hemospusia e krahut 2. injeksioni i muskujve deltoid 3. Ka ndjesi të dukshme kur gjilpëra depërton në vena. 4. Rikthimi i gjakut tregon futjen e duhur. 5. Venat dhe lekura mund të akupunkturohen në mënyrë të përsëritur dhe këto operacione nuk do të shkaktojnë rrjedhje. 6. me venë dhe lekura të ndryshueshme	Copë	4	975.00	3,900.00
3	Maniken (intramuskulare) Simulator i injektimit intramuskular të vitheve [Përkthim] Dizajni i këtij modeli është i thjeshtë dhe i qartë, rajoni i vitheve është pjesë e shenjave të linjës së injektimit, moduli i injektimit. Moduli i injektimit mund të jetë lëng injeksioni, i përshatshëm, lëng i thatë i shtrëdhur, është një produkt ideal që studentët të praktikojnë. [Karakteristikat] 1. Ka një shenjë për të treguar pozicionin e duhur për injeksion; 2. Mbushia e injektimit mund të ndalet për ta zëvendësuar	Copë	4	938.00	3,752.00
4	Maniken komplet Maniken plotë me funksion të plotë të avancuar (mashkull) Karakteristikat 1. Larja e flokëve dhe e fytyrës 2. Larja dhe administrimi i syve dhe veshëve 3. Kujdesi për zgavrën e gojës dhe dhembët artificialë 4. Intubimi endotracheal 5. Kujdesi për trakeotominë 6. Thithja e pëshqymës 7. Thithja e oksigjenit 8. Të ushëruarit me gojë dhe hundë 9. Organet kryesore në zgavrën e krahorit 10. Organet kryesore në zgavrën e barkut 11. Venipunkturë, injeksion, transfuzion gjaku (krahut) 12. Injeksion deltoid nënlekuror 13. Injeksion Vastus lateralis 14. Kaviteti i krahorit, zgavra e barkut, mëlyja, palca e eshtrave dhe punkcioni lumbal 15. Kateterizimi uretral i femrës 16. Kateterizimi i uretrës mashkullore 17. Ujtitja e fshikëzës femërore 18. Ujtitja e fshikëzës mashkullore 19. Injeksion intramuskular i vitheve 20. Infermieri holistik: banjë me sfungjer, ndërrimi i robave, terapia e të flojtit dhe nxehtësisë 21. Lidhjet e gjymtyrëve: për kulja, rotullimi dhe lëvizja e sipërme ose e poshtme [Vlerësimi dhe kujdesi i traumës] 1) larja, dezinfektimi, mbështjellja e plagës; hemostaza dhe fshimi 2) Kujdesi për plagën e qepur me prerje të murit të krahorit 3) Kujdesi për plagën e qepur me prerje të barkut 4) Kujdesi për plagën e qepur të prerjes së lëndimit të kofshës 5) Kujdesi për çarjen e lekurës së kofshës 6) Kujdesi për ulcerat infektive të këmbës 7) Kujdesi për plagën e amputimit të krahut të sipërm 8) Kujdesi për plagën e amputimit nën gju 9) gangrenë e këmbës, kujdesi për plagën e gishtit të parë të dytë të tretë të gishtit	Copë	4	975.00	3,900.00
5	Maniken(reanimimi CPR) Manikin për stërvitje me CPR gjysmë trupi (e thjeshtë elektronike) Produkti ynë ka detektor unik elektronik të thellësisë dhe frekuencës së kompresimit. 1. Funksionimi i parë djathtas: drita 4 treguese në shpatullën e majtë do të ndizet. 2. dritat e fikur: mungesa e baterisë ose gabimi i funksionimit 3. kur të fillojë operacioni, drita e verdhë dhe e gjelbër do të fiket 3. Drita e kuqe: Frekuenca e shtypjes 0-60 rrahje/min Drita e verdhë: Frekuenca e shtypjes 60-80 rrahje/min Drita jeshile: Frekuenca e shtypjes 80-100 rrahje/min 1) funksionimi i duhur: 2 drita jeshile në Frekuencën e shtypjes >100 rrahje/min 2) ndërje e dritës së kuqe: thellësia e ngjeshjes e pamjaftueshme	Copë	4	998.00	3,992.00
6	Tavolin per nevojja te pacientit Tabela mbi shtrat Abs me susta gazi Platforma e sipërme ABS Rregullim i lartësisë së kontrolluar me amortizator Rrënjë rrotulluese 360° Pjesë metalike të veshura me nano qeramike, të veshura me pluhur Platforma e sipërme e lehtë për t'u pastruar	Copë	4	225.00	900.00
7	Tavolinë per barna Karroca e anestezisë dhe barna ABS Strehimi plastik Kuti materiale me kapak transparent Sistemi i sirtarëve të ndarë me mbyllje qendrore (1 i madh, 2 i mesëm, 2 i vogël) Kuti e grumbullimit të gjilpërave të disponueshme Stenda për përgatitjen e ilaçeve që hapet Kasor me diametër 125 mm me frena kryq	Copë	4	245.00	980.00
8	Shtrat elektronik per pacient 2 Krevat spitalor Motors Lëvizja e shpinës dhe e këmbës me anë të motorëve Binarët anësor lehtësisht të fshihet dhe të kycura Lehtë për t'u hequr dhe instaluar panelet e kokës dhe këmbës PP Pozicionet e auto-konturës së Fowler dhe Vaskulare Platformë me sipërfaqe të shtrirë çeliku me katër ndarje Pjesë metalike të lyera me pluhur elektrosiatik të veshura me nano qeramike Rregullimi i mbështetës së këmbëve me arpon Shylla IV e rregullueshme me lartësi Rrënjë me diametër 125 mm 360° rrotullues që mbyllet në mënyrë diagonale Mbrojtëse mbrojtëse në të katër qoshet Shylla IV dhe follet shites në të katër qoshet	Copë	4	480.00	1,920.00
9	Shtrat static (OTOMAN) Tabela e ekzaminimit Sipërfaqe shtrirë e mbuluar me lekure sintetike Mbështetësja e rregullueshme e shpinës (Manual) Këmbët e palosshme Kornizë e veshur me pluhur nano qeramike. Trupi kryesor me besueshmëri të lartë.	Copë	4	275.00	1,100.00

10	Paravan (perde ndarese) Ekran i palosshëm i spitalit Kornizë metalike e veshur me pluhur epoksi Fale strukturore së saj të palosshme me 3 ndarje, mbulon lehtësisht zonën ku përdoret. E punuar me pëlhurë të cilësisë së lartë 100% pambuk Manovrim i lehtë fale rotave të pozicionuara në qoshe	Copë	6	145.00	870.00
11	Komodin pran shtratit Trup prej druri me rimorso melamine Platforma e sipërme e lehtë për t'u pastruar. Binarët teleskopik të sirtarëve. Doreza estetike	Copë	8	165.00	1,320.00
12	E.K.G Makina EKG me 12 kanale, duke përdorur teknologjinë e izolimit dixhital dhe përpunimin e sinjalit dixhital, ka dy mënyra pune, manuale dhe automatike. Përveq inspektimit të stabilizimit bazë dhe tastierës së plotë alfanumerike silikoni, ai gjithashtu mbështet ruajtjen e diskut U. Makinë EKG 12 kanale me interpretim Ekran LCD TFT me ngjyra 7 inç Blerja e njëkohshme e 12 klientëve dhe (Manual/Auto) Regjistrim me printer teknik me rezolucion të lartë Mënyrat e punës manuale/automatike Përdorni teknologjinë e izolimit dixhital dhe përpunimin dixhital të sinjalit Inspektimi i stabilizimit bazë Tastierë e plotë alfanumerike silikoni Mbështet ruajtjen e diskut U	Copë	4	988.00	3,952.00
13	Karrocë invalidësh Mbështetës fiks për krahë, jastëk PVC - mbështetëse këmbësh e fiksuar, pllakë rrokullisjeje, me rrip këmbësh - Rrotat e përparme të forta 20 cm (8") - Rrotat e pasme të forta 61 cm (24") - mbyllja e frenave në rrotat e pasme - xhep në anën e pasme Specifikimet teknike • Gjerësia totale: 59 cm • Permasat e palosura: 27 cm • Gjerësia e sediljes: 41 cm • Diametri i rotave të pasme: 59 cm • Diametri i rrotës së përparme: 20 cm • Lartësia e sediljes: 47 cm • Lartësia totale e karrigës me rrota: 86 cm • Gjatësia totale e karrigës me rrota: - • Lartësia e mbështetëses: - • Thellësia e sediljes: - • Ngarkesa maksimale: 100 kg • Madhësia e kompletit: 95 x 27 x 93 cm • Peshë neto: 15 Kg • Peshë bruto: 17 Kg	Copë	4	378.00	1,512.00
14	Aspirator - është një aspirator kirurgjik që punon me rrethim elektrik 230V ~ / 50 Hz, që përdoret për aspirimin e lëngjeve të trupit (mukosit ose katarës dhe gjakut). Pajisja është e pajisur me 4 rota antistatike me dy frena, për t'u përdorur në dhomën e operacionit dhe dorezë levizjeje. Lehtësisht i levizshëm dhe i projektuar për përdorim praktikisht të vazhdueshëm. Fale këtyre karakteristikave dhe vlerësimit që ka, ky produkt është veçanërisht i përshtatshëm për përdorim spitalor, për pacientë të trakeotomizuar dhe për aplikime kirurgjikale. Produkti furnizohet me dy kavanoza 2000cc polikarbonat të autoklavueshëm me një valvul tejkalimi dhe të pajisur me një regullator aspirimi dhe tregues vakumi të vendosur në panelin e përparmë. versioni me telekomandë, versioni me kavanoza 4 litra, versioni me regullues të drejtimit të rrjedhjes) dhe siguresë 1 x 4 A 250 V. Me vakum të lartë / rrjedhje të lartë ISO 10079-1. Me aspirim maksimal të thellësisë -0.90 Bar dhe punjë maksimale thellësie 60 l/min. Ka funksionim të vazhdueshëm dhe peshon 16 kg. Dimensionet janë 460 x 600 (h) x 420 mm. Aksesorët standardë janë një grup tubash 8x14 mm, një lidhës sondë, një filër antibakterial dhe një kavanoz aspirimi 2000cc. Aksesorët sipas kërkesës janë kavanozi i aspirimit 4000cc, telekomanda dhe përzjedhësi i kavanozit.	Copë	4	620.00	2,480.00
15	AmbuMaska Maskat e fytyrës silikoni fshyen vetë dhe presioni i manshetës mund të rregullohet për një mbyllje të lehtë dhe efikase. Ata janë të rehatshëm për t'u kapur dhe kanë një mbështetëse gishi në mënyrë që shpëtimtarët të mund të arrijnë një vulosje të ngushtë. Kontrollat vizuale të gjakderdhjes, të vjellave dhe frymëmarrjes spontane mund të bëhen përmes kupolës transparente. Autoklavohet në 134°C	Copë	4	75.00	300.00
16	Laringoskop Seti i laringoskopit HEINE Classic+ është krijuar posaçërisht për të ofruar diagnoza të besueshme dhe efektive. Ai përmban një dorezë HEINE me një llambë të teknologjisë së ndriçimit LED që arrin një intensitet maksimal të dritës dhe një interpretim perfekt të ngjyrave. Është 3 herë më e ndritshme se llamba halogjene konvencionale, duke pasur homogjenitet. Ofron një dritë të bardhë shumë të ndritshme me një temperaturë referimi ngjyrash prej 5200 Kelvin dhe kontrast të zgjeruar. Ka një jetëgjatësi prej 50,000, mund të sterilizohet dhe pastrohet me lehtësi. Seti i laringoskopit HEINE Classic+ përdor tehe me fibra optike, teknologji pioniere të fibrave optike për ndriçim me efikasitet të lartë, me një reze fibrë optike HEINE HiLite me fibra optike 6500 me një diametër prej 4,3 mm për shkelqim të madh dhe të besueshëm. Ka një aplikim të thjeshtë dhe të sigurt fale teknologjisë HEINE smoothsurface, pa rrezik lëndimi, me kontroll të plotë të cilësisë dhe dizajn të veçantë pa boshllëqe dhe pika të tjera që janë burim mikrobesh, në mënyrë që ato të pastrohen lehtësisht. Seti i laringoskopit HEINE Classic+ përmban: Blade Pediatric Paed 1 Mac Blade 1 (gjatësia 94 mm) Mac Blade 2 (gjatësia 114 mm) Mac blade 3 (gjatësia 134 mm) Kuti mbajtëse dhe ruajtëse	Copë	4	148.00	592.00
17	Kaseta per instrumente(Pean,pincet,gershëre etj.) Karroca e mjekimit ABS Strehimi plastik Sistemi i bllokimit qendror 1 sirtar i madh me ndarje Koshi i mbeturinave mjekësore Kuti magazinimi Sirtarët e ilaçeve me hapje të dyanshme 50 kuti me ndarje ilaçesh Rrotulla me diametër 125 mm me frena krva	Copë	4	85.00	340.00
18	Peshore dhe matese per gjatesi ekran BMI Peshore personale profesionale me stende dhe sham të lakuar butësisht tregues. Ndërsa ngjiteni në peshore, ekranin aktivizohet automatikisht dhe peshë shfaqet me ndriçim të kuq numrat. Nuk kërkon asnjë operacion dhe është i përshtatshëm për institucionet mjekësore, zonat e mirëqenies dhe farmaceut. Peshore me shufër lartësie të integruar Soehnle 7831 (27276) me shufër qendrim të lartë dhe lartësi kalon automatikisht nga kg në cm nëse shufra e lartësisë është e ngritur. Pacientët mund të jenë njëkohësisht të peshuara dhe të maturu. Karakteristikat: - shufra e integruar me lartësi nga 120 cm në 202 cm - i lehtë për t'u përdorur, tasi tar në pjesën e pasme të ekranit - Treguesi i shkalës së shamit (trashësia e shamit 8 mm) - Ekran LED i ndritshëm: 5 shufra, lartësia 15 mm	Copë	4	145.00	580.00
19	Kambolë per Infuzione Baza Plastike me Pol IV Trupi kryesor plastik 4 grupa Gjatesia e rregulloshme Rriza rrotulloese Bartës i levizshëm i infuzionit	Copë	4	75.00	300.00
20	Urinar femëror	Copë	4	88.00	352.00
21	Urinar Mashkullor	Copë	4	88.00	352.00

22	Sterilizator (Autoklav) 50 LIT TIPARET Kutia e jashtme e bërë nga çelik inox. INCOLOY elemente ngrohëse çelik pa çelik, i fortë, rezistent ndaj korrozionit dhe i lartë temperaturat. Lidhja RS-232. Porta e jashtme e sondës anësore. Dhoma e sterilizimit dhe dera prej çeliku inox. Pastrim automatik në atmosferë PANELI I KONTROLLIT 1. Matës presioni. 2. Treguesi i ndezur i alarmit. 3. Dera treguese e ndezur e hapur 4. Shfaqja e temperaturës. 5. Shfaqja e kohës 6. Butoni i vendosjes së temperaturës (vargu nga 115 °C deri në 134 °C). 7. Pushbutton rrit vlerën. 8. Shtypni butonin START 9. Shtypni butonin STOP 10. Shtypni butonin Ulni vlerën. 11. Shtypni kohën e zgjedhjes së butonit, (nga 3' deri në 99'). 12. Shtypni butonin për të hapur kapakun. 13. Butoni i shlycjes së avullimit.	Copë	4	920.00	3,680.00
TOTAL					40,994.00

II. MATERIALI SHPENZUES		Njësia	Sasia	Çmimi per njesi	Çmimi total me TVSH
1	Kanilla 21 G,24 G	Pako	100	9.50	950.00
2	Katetera urinar selikon 16-18	Pako	30	7.50	225.00
3	Katetera urinar gome 16-18	Pako	20	7.00	140.00
4	Qese urinare	Pako	20	6.50	130.00
5	Epruveta të ndryshme	Pako	2	5.00	10.00
6	Shiringa -subcutan	Pako	4	6.00	24.00
7	Shiringa -10 ml	Pako	50	7.50	375.00
8	Shiringa -2 ml	Pako	20	9.00	180.00
9	Shiringa -3 ml	Pako	10	12.00	120.00
10	Shiringa -5 ml	Pako	30	13.00	390.00
11	Lubrikant	Pako	20	15.00	300.00
12	Vate/symbuk jo steril	Pako	100	2.50	250.00
13	Alkohol-Antiseptik per pendorimin e jashtem	Pako	100	4.50	450.00
14	Tensiometer	Copë	20	23.00	460.00
15	Glikometer (koplet)	Copë	20	27.00	540.00
16	Lanceta	Pako	100	15.00	1,500.00
17	Shirita per Glikometer	Pako	100	18.00	1,800.00
18	Kosh per hudhjen e mjeteve te mprehta	Pako	20	4.50	90.00
19	Sondë nazogastrike per te rritur	Pako	10	10.00	100.00
20	Sondë nazogastrike per femije	Pako	10	12.00	120.00
21	Gaza sterile 5x5	Pako	10	7.00	70.00
22	Gaza sterile 10x10	Pako	10	9.00	90.00
23	Gaza sterile 4x4	Pako	10	12.00	120.00
24	Gaza jo sterile	Pako	50	8.50	425.00
25	Fasha elastike 4cm	Pako	20	7.50	150.00
26	Fasha elastike 6cm	Pako	20	6.00	120.00
27	Fasha elastike 8cm	Pako	20	9.00	180.00
28	Mushema leter 60x60 cm	Pako	50	7.50	375.00
29	Leukoplast	Pako	20	6.00	120.00
30	Dobosh madhesi te ndryshme	Copë	6	22.00	132.00
31	Doreza jo sterile-M	Pako	10	7.50	75.00
32	Doreza jo sterile-L	Pako	10	7.80	78.00
33	Doreza jo sterile-XL	Pako	10	9.50	95.00
34	Doreza sterile -S	Pako	6	9.20	55.20
35	Doreza sterile -M	Pako	10	9.00	90.00
36	Doreza sterile -L	Pako	10	8.50	85.00
37	Doreza sterile -XL	Pako	10	7.50	75.00
38	Gjilpera 21 G	Pako	10	8.00	80.00
39	Gjilpera 22 G	Pako	20	12.00	240.00
40	Kalaqe	Pako	20	9.00	180.00
41	Kapela	Pako	20	10.00	200.00
42	PulsOksimeter	Pako	20	45.00	900.00
43	Flakona	Pako	10	12.00	120.00
44	Ampula	Pako	10	9.00	90.00
45	Shaptulla	Pako	10	13.00	130.00
46	Projektor per kabinet	Pako	4	335.00	1,340.00
47	Jastek,set qarshafesh,peshqira,pizhame,botanije	Pako	8	25.00	200.00
TOTAL					13,969.20

I. MJETET E PUNËS	40994.00
II. MATERIALI SHPENZUES	13969.20
TOTAL - KABINETIN E INFERMIERISË	54963.20


2. KABINETI I FIZIOTERAPISË

Nr	Artikulli	Njësia	Sasia	Çmimi pa TVSH	ÇMIMI
----	-----------	--------	-------	---------------	-------

1	Karrige me rrota të palosshme Gjerësia 59 cm Përmasat e palosura: 27 cm Gjerësia e sediljes: 41 cm Diametri i rrotave të pasme: 59 cm Diametri i rrotës së përparme: 20 cm Lartësia e sediljes: 47 cm Lartësia totale e karrigës me rrota: 86 cm Gjatësia totale e karrigës me rrota:- Lartësia e mbështetëses:- Thellësia e sediljes:- Ngarkesa maksimale: 100 kg Madhësia e kompletit: 95 x 27 x 93 cm Pesha neto: 15 Kg Pesha bruto: 17 Kg		Copë	2	270.00	540.00
2	Barellë profesionale Barellë me 2 ndarje, e krijuar posaçërisht për përdorim te pacientët transferimi Lëvizja e pasme me siguri të lartë e rregullueshme me ndihmën e gazit pranverë Përdorim i lehtë dhe i sigurt falë shinave anësore të palosshme Pjesë metalike të veshura me pluhur elektrostatik të veshura me nano qeramike Shasi çeliku e qëndrueshme, higjienike dhe rezistente ndaj përplasjeve. Platformë dysheku e formuar me fletë çeliku Poli IV me dy faza Këndet e barellës të pajisura me parakolp mbrojtës të cilësisë së lartë Doreza shtytëse në kokë dhe këmbë të përshtatshme për ergominën e duarve Shtylla IV dhe foletë shtesë në të katër qoshet Mbulesë PU e papërshkueshme nga uji, që mbron nga flaka Urinën grepa në të dy anët e barellës Pedale qendrore të frenave në kokë dhe në majë të këmbës të përshtatshme për këmbë ergomi Rrotat e kthyeshme 360 gradë me kyçe qendrore 150 mm (opsionale) Platforma e mbështetjes për mbledhjen e gjakut të shtuar (Opsionale) Platforma e ngrënies që mund të funksionojë në kangjella (Opsionale) Mbajtës i cilindrit të oksigjenit (opsionale) Rrapi i sigurimit të pacientit (opsionale) Mbështetje për defibrilator (opsionale)		Copë	2	380.00	760.00
3	Karrige e këmbës - dy hapa Përbërësit metalikë të tubave të rrumbullakët 2 hapa Trup metalik i veshur me pluhur Këpuçe plastike në mbështetëse të këmbëve		Copë	2	58.00	116.00
4	Paravan Kornizë metalike e veshur me pluhur epoksi Falë strukturës së saj të palosshme me 3 ndarje, mbulohet lehtësisht zona ku përdoret. E punuar me pëlhurë të cilësisë së lartë 100% pambuk Manovrim i lehtë falë rrotave të pozicionuara në		Copë	4	118.00	472.00
5	Kaliper digjital me software Kaliper profesional me palosje lëkure - dixhital me kablo PC për transferimin e të dhënave USB -Mundësia e rikalibrimit ""Skinfold caliper"" ka susta të cilat ushtrojnë një presion prej 10 g/mm2 në palosjen e lëkurës dhe një shkallë të saktë që mat trashësinë në mm. - Lehtë për t'u përdorur dhe lexuar Me ekran dixhital, është i pajisur me foto që tregon pozicionet e kështilluara për matje. Tabelat do të ndihmojnë në marrjen e përqindjes së saktë të yndyrës trupore nga të dhënat e matura dhe për të bërë një vlerësim të saktë të pacientit. -Menaxhimi i të dhënave në PC Për transferim të menjëhershëm të të dhënave në shumicën e programeve (Excel, Word, Open Office, ...). Kërkesat: Windows 2000, XP (Service Pack 2), 7, Vista. Minimumi USB 2.0."		Copë	4	45.00	180.00
6	LED PODOSCOPE Kapaciteti: 135 kg - 297 lbs Përmasat: 43.5x42.5xh 22 cm - 17.12x16.75x8.67 inç Pesha: 8 kg - 17,63 lbs Tensioni i funksionimit: 220 V-50/60 Hz Shirit LED me dritë jeshile me 25,000 orë jetëgjatësi		Copë	4	75.00	300.00
7	Çekiçët per refleks. "Çekan refleks neurologjik Pesha: 90 g Gjatësia: 18 cm"		Copë	10	15.00	150.00
8	Sphygmomanometër aneroid me stetoskop Sphygmomanometra me manshetë najloni me mbyllje velcro, manometër i besueshëm me kapëse për t'u fiksuar në manshetë. Shkalla 0-300 mm Hg. Lëshimi i ajrit në rubinetin e mbyllur maksimumi 4 mm Hg/minutë. Vendosja manuale e deflacionit është e mundur deri në 2/3 mm Hg. Koha maksimale e deflacionit nga 260 mm Hg deri në 15 mm Hg 10 sek. Shkalla gradohet çdo 2 mm Hg. Zero lundruhet (treguesi nuk ka pikë ndalimi, por lëkundet lirshëm), manshetë velcro najloni, llambë lateksi me valvul të kromuar. Rubineti ajri i kromuar me rregullim të lëshimit të ajrit me valvul me vidë.		Copë	4	75.00	300.00
9	GONIOMETER - 205x45 mm Me shkallë rrethore që përdoret për të kontrolluar madhësinë e nyjeve të ljeve dhe këndin e qafës së femurit në rrezet X. Personalizim me logon tuaj për minimum 1000 copë. Përdoret nga kirurgët ortopedë për të matur diapazonin e lëvizjes së kyçeve: bërryla, gjunjë dhe gishta.		Copë	15	45.00	675.00
10	Meter shirit Masë shiriti i tërheqshëm xhepi 150 cm. Llogaritësi BMI (Indeksi i masës trupore) në panelin e përparmë		Copë	3	22.00	66.00
11	LLamba TERAPIKE INFRA KUQE 250 W - levizese LAMP TERAPIKE INFRA KUQ - 250 W - Koka e karrocave Ø min 20 cm. Gjatësia e krahut 90 cm (45 + 45). Krahu i balancuar i brendshëm i pranverës lejon pozicione të ndryshme.		Copë	4	45.00	180.00

12	Stimulus elektrik i muskujve (pajisje portative TENS) Me 60 programe mjekësore Pajisja elektroterapeutike shumëfunktionale me dy kanale gjeneron stimulim elektrik për të ndihmuar në lehtësimin e dhimbjeve, stërvitjen dhe relaksimin e muskujve. Lehtë për t'u përdorur, Gima-care ka 2 programe të paracaktuara trajtimi me kohë trajtimi të rregullueshme dhe 1 program të personalizuar për çdo pjesë të trupit, duke i lejuar përdoruesit të rregullojnë kohën e trajtimit dhe frekuencën dhe gjerësinë e pulsit. 3 në 1 Dhjetëra + Ems + Masazh Forma e valës profesionale dhjetëshe (frekuencë dhe gjerësi e ndryshueshme e pulsit) ilustrim i pjesëve të trupit 60 programe (10 pjesë të trupit, 40 nivele) prodhim i fuqishëm (maksimumi 120 mA) (në ngarkesë 500 ohm) dizajni i fortë dhe i qartë Funksionim i vazhdueshëm për rreth 10 trajtime nëse karikohet plotësisht. Furnizohet me 4 pads 50x50 mm, 2 kablo dalje, 1 kablo USB. Manuali i përdorimit (GB, FR, IT, ES, DE).		Copë	20	38.00	760.00
13	Biciklete statike Treni me makinë: rrip - pajisje fikse Sistemi i frenimit: këpucët e frenave të ndjera me jetë të gjatë. Leva e frenave për ndalim emergjent Sistemi i volantit: 18 kg (i balancuar) Pesha maksimale e përdoruesit: 125 kg Konsola me LCD: distanca, koha, kaloritë, shpejtësia, skanimi Pozicioni i sediljes: shalë dyngjyrësh me rregullim vertikal dhe horizontal Distanca e pedalit/sediljes: min 70 cm, maksimumi 90 cm Shiriti i timonit: rregullim vertikal Lartësia e timonit: min 92,5 cm, maksimumi 104 cm Lartësia e shalës: min 70 cm, maksimumi 89 cm Pozicioni i shalës përpara dhe pas: min 61 cm, maksimumi 70 cm Rregullimi i rezistencës: manual - mikrometrik Rrotat lëvizëse: po Këmbët e rregullimit të gomës: po Mavija e pedalit: 3 copë Q Faktori: Gjithësej: 17,8 cm. - Majtas: 8,9 cm Djathtas: 8,9 cm Korniza: çeliku me densitet të lartë Pikturë: Veshje me pluhur të rëndë Pesha: 37 kg Madhësia e konfigurimit: 1070 x 510 x 1150 mm Pesha bruto: 42 kg Madhësia e paketimit: 1070 x 205 x 830 mm Certifikimi: CE-ROHS-EN957		Copë	4	750.00	3,000.00
14	Ulese rrëshqitëse Kornizë çeliku me tuba, përfundim i ndritshëm i kromuar, madhësia 60" e gjatë x 13" e gjerë. Sedilja e mbushur me shkumë e projektuar posaçërisht është e pajisur me KATËR rrota nalloni dhe rrëshqet pa probleme mbi kornizë. Vjen me PESË burime të tensioneve të ndryshme dhe me dy tension të lartë		Copë	4	170.00	680.00
15	Shufra paralele - 3 m Rregullim i lehtë i lartësisë Baza e qëndrueshme prej çeliku me mbrojtje plastike për dyshemenë Opsioni i ruajtjes që kursen hapësirë duke i shtyrë shiritat së bashku Opsioni më i lehtë i rregullimit nga një person Nënstruktura përbëhet nga një konstruktion i qëndrueshëm çeliku me mbrojtje plastike për dyshemenë Trajtimi më i lehtë i rregullimit të lartësisë së kromuar, duke përdorur bulonat shtrëngues Llojet e kompensatës kanë një gjatësi prej 300 cm Baza: 65 cm Hapësira e vrimave: 30-58,5 cm Pesha e vet: 70 kg Kapaciteti maksimal i ngarkesës: 140 kg Përmasat: LxWxH 300x65x75-108 cm		Copë	4	128.00	512.00
16	Shkelete nga druri "Kufiri i peshës 300 kilogramë Dimensionet e vogla 10" x 12" x 2" Dimensionet mesatare 13" x 14" x 4" Dimensione të mëdha 16" x 18" x 6" Dimensionet X-Large 19" x 21" x 8" Materiali Natyror Polifonik i Mëshhtëknës JO pa lateks"		Copë	4	78.00	312.00
17	Shufra paralele ne kende Handrails adjustment 65-100 cm Platform width 59 cm Base width 70 cm Length of the two platforms 200-270 cm Single handrail maximum load 135 Kg		Copë	4	48.00	192.00
18	Këmbë lëkundëse-TEMIX FOOT Tabela e rrumbullakët ushtrimore në dru kundër rrëshqitjes Ø 40 cm"		Copë	4	17.50	70.00
19	"Rrota e shpatullave (montimi në mur) aparate per ushtrimin e shpatullave model muri e pajisur me 4 krahë 130 cm dhe 4 krahë 110 cm rrrokje që nuk rrëshqet lartësi e rregullueshme dhe rezistencë e ndryshueshme dimensionet: 132 x 25 x 200 cm"		Copë	4	25.00	100.00
20	Vaske ngrohëse Vaskë ngrohëse e kontrolluar elektronikisht për përgatitjen e parafinës dhe fangos kapacitet prej 28 litrash funksionon sipas parimit "në një tenxhere të dyfishtë". trup inox me panel kontrolli përpara termostati - llambat pilot - treguesi i temperaturës Sterilizimi është i mundur në 90°C Temperatura e funksionimit: 50 - 65°C dimensionet: 60 x 37 x 29 cm 230V~ 50/60Hz - konsumi: 800 W - CE		Copë	4	12.00	48.00
21	"Pegs Board / Perceptual Motor Dërrasë portative 6" x 6" me 100 vrima me 300 kunjë me shumë ngjyra.		Copë	10	10.00	100.00

22	Tabela me kunj me shumë formë Pilakë me kunj me shumë formë, Madhësia: 35cm X 15cm		Copë	10	25.00	250.00
23	Tabela me kunja katrore (20 kunjë)		Copë	10	35.00	350.00
24	Tabele druri me kunj të rrumbullakët Dërrasë me kunj katrore me 30 vrima për fëmijët e vegjël për të mësuar aftësitë matematikore dhe koordinimin e shkëlqyer motorik. Kunjtat prej druri, shumëngjyrëshe 2,75 inç të gjatë.		Copë	10	25.00	250.00
25	C.P.Ball - (Diametri:65cm,75cm,85cm) Topa per trup 65 CM - KALTER Topa per trup 75 CM - E VERDHE Topa per trup 85 CM - KUQ		Copë	10	10.00	100.00
26	"Peshore mjekësore: 1Kg,2Kg,3Kg,4Kg,5Kg. - trap vinili 1 kg - trap vinili 2 kg - trap vinili 3 kg - trap vinili 4 kg - trap vinyl 5 kg"		Copë	10	15.00	150.00
27	Shpatullore muri bërë prej druri të thjeshtë lartësia: 240 cm - gjerësia: 100 cm 16 shkallë të thjeshta me fiksime të padukshëm vertikale të forta të rrumbullakosura dhe dy shkallë të zhytura në një lartësi prej ± 160 dhe 210 cm		Copë	5	178.00	890.00
28	Ushtrime Pronator & Supinator Kjo pajisje përdoret për të drejtuar pacientin përmes lëvizjeve prono-supinuere me parakrah. Një mbështetje krahut e rregullueshme në lartësi e mban shpatullën në një pozicion neutral të rehatshëm. Një dorezë e rregullueshme në lartësi siguron rezistencë me intensitet të ndryshueshëm. Pacientit i kërkohet të kapërcejë rezistencën e përcaktuar nga terapisti. përmasat: 40 x 20 x h 20 cm pesha: 2,6 kg		Copë	4	223.00	892.00
29	Set për ushtrime DRITA E KYÇARISË - E VERDHE - SET 5 ANKLECISER MESIMOR - I KUQ - SET 5 ANKLECISER HEAVY - E GJELBËR - SET 5 ANKLECISER EXTRA HEAVY - BLU - SET 5		Copë	20	25.00	500.00
30	Trampoline per ushtrime diametri i trampolinës 102 cm 48 susta speciale dhe konstruktion i rrumbullakosur për siguri ngarkesa maksimale: 150 kg"		Copë	4	75.00	300.00
31	Ergo panel muri "Panel muri me 7 vegla për stërvitjen e lëvizjeve të aktiviteteve të çdo dite të veshjes dhe zhveshjes Elementet e ndryshme janë të fiksuara në panel: seri kockash shtypëse, seri butonash, kopsa, zihur, lidhëse të kryqëzuara, lidhëse horizontale, vidë me rrrathë me rezistencë të rregullueshme. Dimensionet: 39,5 x 9 x 89 cm Pesha: 5,5 kg"		Copë	4	228.00	912.00
32	"Jastekë - madhësi të ndryshme ROLL GIYRI - 40 X 12 CM - GRI ROLLO QYTË - 50 X 15 CM - GRI ROLL GIMNASTIK DHE MASAZHE - 50 X 23 CM - GRI ROLL - 50X18X13,5 CM - GRI GIYSM ROLL - 50 X 18 X 9 CM - GRI BOLSTER - 50 X 10 CM - E FORTË - GRI BOLSTER - 50 X 15 CM - E FORTË - GRI BOLSTER - 50 X 20 CM - E fortë - GRI"		Copë	5	32.00	160.00
33	"Dyshek-200x100x6 cm. dyshek dyshemeje për kabinetin gjerësia: 5 cm (4 cm shkumë PE dhe 2 cm shkumë PV) shpërndarja optimale e presionit shumë e rehatshme - e mbuluar me skai lehtë për t'u pastruar - fund kundër rrëshqitjes dimensionet: 200 x 120 x 6 cm"		Copë	3	145.00	435.00

34	Treadmill monitor: 10" 4 LED + ndriçim LCD programet: 44 gjuhët: angleze motori: 5,0 HP DC shpejtësia: 0,8 - 20 km/h lartësia: 0 - 15% Sipërfaqja e drejtimit: 50 x 140 cm Lloji i kuvertës së drejtimit: 18 mm I palosshëm: po, Soft Drop System Thithja e goditjeve: T-Flex Comfort Plus Pesha maksimale e përdoruesit: 135 kg furnizimi me energji elektrike: 230V - 50/60Hz dimensionet: L177 x L 83 x L 143 cm dimensionet e palosura: L 102 x L 83 x L 155 cm pesha: 87 kg rrip vrapimi: 1,6 mm Diamanti kontrolli i dorezës: shpejtësia/lartësia rrahjet e kontaktit të zemrës marrës telemetrik HR rripi i gjoksit 5 kHz: opsion rrota transporti Lidhja Bluetooth Karikeues USB 5V DC - 2,1A aplikacionet (Android dhe IOS): Tunturi Routes, AnyRun dhe Kinomap mbështetje për tabletin numëruesi i hapave"		Copë	4	620.00	2,480.00	
35	Terapia e duarve-Digi-extend Aparat terapie për ushtrime me gishta, aduksion dhe rrëmbim. Zhvillon forcën e izoluar të gishtit, fleksibilitetin dhe koordinimin. Rezistenca progresive e koduar me ngjyra i jep pacientit reagime pozitive. Përfshin një dore + 4 rezistenca të ndryshme.		Copë	10	15.00	150.00	
36	Pirunet akordues - 128Hz		Copë	4	10.00	40.00	
37	Shtrat terapie me dy seksione 1 motor Divan ekzaminimi me rregullim të lartësisë (48-95 cm) me aktivizues elektrik (motori Linak 6.000 N) i kontrolluar nga çelësi i këmbës me seksion koke lehtësisht të rregullueshëm (në +60° dhe -10°) nga një pompë gazli. Struktura e fortë dhe elegante e këmbës në tub ovale 50x25x2 mm, kornizë qendrore në tub drejtkëndor 50x20x1.5 mm e lyer me pluhur epoksid të bardhë RAL 9003. Trashësia minimale 70/80 mikron, përfundimi me shkëlqim. Platformë shkumë poliuretani me densitet të lartë me bazë druri të mbuluar me tapiceri lëkure. Të dy materialet janë të papërshkueshëm nga zjarri të klasës 1 IM. Lëkurë që lahet me detergjent më të zakonshëm. Përmasat: 190x60xh 48/95 cm. Pesha: 70 kg Ngarkesa maksimale: 150 kg. Fuqia e funksionimit: 100-240 V, 50/60 Hz. Përfshihet mbajtësja e rrotullës së divanit.		Copë	4	480.00	1,920.00	
38	Shtrat terapie me gjashtë seksione 2 motorë Elektrike - çdo ngjyrë Seksionet: 6 Ngarkesë e sigurt e punës 180 kg Rregullimi i lartësisë (48-100 cm); shirit këmbësh Tabelat e ekzaminimit dhe trajtimit me dy motorë, rregullimi elektrik i lartësisë me anë të shiritit të këmbës ose një ndërprerës këmbësh me tension të ulët (24 V). Divanet kanë gjashtë ose tetë seksione: pjesa e trunqut mund të rregullohet elektrisht nga operatori pa asnjë përpjekje, duke përdorur tastierën prapa kokës së tavolinës, ndërsa pacientit i nënshtrohet një trajtimi; seksionet e tjera mund të rregullohen nga një ose më shumë sisteme burimesh gazli. Seksioni i kokës është i pajisur me një vrimë frymëmarrjeje të zgatur për një rehati më të lartë. Është një tabelë e dedikuar terapie për teknikat e lirimit miofascial dhe analizën posturale. Gamë e gjerë e pozicioneve të mundshme në përkulje/zgjatje, simetrike ose asimetrike. Fuqia 230 V - 50/60 Hz. Furnizohet me spinën e vrimës së hundës dhe manualin e ushtrimeve të edukimit postural. Rrotat e anulueshme: pasi rrotat tërhiqen, qëndron tavolina në kornizë		Copë	4	775.00	3,100.00	
39	Elektroterapia, ekografia ULTRAZERË 1-KANAL, Ekran me prekje me ngjyra Mini 4 inç i lëvizshëm dhe me bateri Protokollet e paracaktuara dhe enciklopedia terapeutike Koka ergonomike me identifikim vizual të aksesoreve / tregues vizual të kontaktit të pacientit Apikues me ngrohje me shumë frekuenca: disponohen 1 dhe 3 MHz. Trajtim i njëkohshëm me 1 dhe 3 MHz Përmasat 380 x 190 x 260 mm Pesha max. 3 kg Furnizimi me rrjet 100-240 V/AC, 50-60 Hz Numri i kanaleve të pavarura 1 Numri i kokave të lidhura njëkohësisht 2 Frekuenca modulare 10-150 Hz Faktori i detyrës 5%-100% Maks. Intensiteti në modalitetin e vazhdueshëm 2 W/cm2 Maks. Intensiteti në modalitetin pulsues 3 W/cm2 Aksesorë standardë: kokë ultrazëri 5cm2, xhel 300ml, tregues stilolapsi i ekranit me prekje, përshatës. Aksesorë shtesë: Kokë ekografie 1 cm2 , Kokë ultratinguj 5 cm2.		Copë	4	720.00	2,880.00	
40	Karrige te rrumbullakta me mundësi rregullimi te lartësisë kornizë ekonomike e stolit të pajisur me një stendë me pesë këmbë të montuara mbi rrota rrotulluese sedilje e veshur me susta të rrumbullakëta e mbuluar imitim lëkure Ø 36 cm me shirit gazli të zi, kontroll i lartësisë nga 42 në 55 cm		me	Copë	10	35.00	350.00
41	Karrige te rrumbullakta me mbështetese Për përdorim profesional, i ndërtuar plotësisht në çelik inox, rrotullues me rrotullim 360° që thyhen vetë, me gomë. Lartësia mund të rregullohet lehtësisht me anë të një pompe gazli; mbështetja e shpinës është rrotulluese 180° dhe e rregullueshme në thellësi, e mbushur me densitet të balancuar dhe e veshur me Peltex. Lartësia minimale/maksimumi: 530/660 mm.		Sedilja është	Copë	5	48.00	240.00
42	Shkallët e rehabilitimit Strukturë çeliku e veshur me pluhur, pjesë rrëshqitëse me zink-kromat. Teleskopik, i rregullueshëm në lartësi, pluhur parmakë anatomike metalike të veshura. Dorezat parandalojnë lirin dhe lëvizjen e parmakut kur përdoret nga pacientët. PVC pa rrëshqitje të mbulura me shkallë të mbyllura në dy lartësi të ndryshme. Shkallët mund të vendoset në pozicion të drejtë si dhe në pozicion qoshe. Rregullimi i parmakut 60 – 100 cm Gjerësia e hapit 56 cm Thellësia e hapit 30 cm Lartësia e hapit 13 – 16 cm Ngarkesa maksimale me një parmak të vetëm 135 kg			Copë	4	185.00	740.00

43	Pasqyre ergonomike levizese Në qëndrim rrotullues në epoksid të bardhë Shumë e fortë, pasqyra dhe aglomerati i zgjeruar formojnë një bllok të vetëm, duke garantuar kështu qëndrueshmërinë maksimale. Kornizë në formë U, me një peshë minimale Edhe në rast vrimash, fragmentet e pasqyrës ngjiten në pjesën e poshtme të aglomeratit për siguri më të madhe. dimensionet: 100 x 170 cm"		Copë	4	75.00	300.00
44	Derrase levizese Tabela e stërvitjes tip "Freeman" në dru kundër rrëshqitjes dimensionet: 45 x 30 cm		Copë	4	60.00	240.00
45	Derrase e bilanci Bobath materiali sintetik model i madh dimensionet: Ø 60 x H 14 cm		Copë	4	25.00	100.00
46	Kolona vertebrale fleksibël me koke Një kolonë vertebrale fleksibël me madhësi jetësore që përbëhet nga pllaka okupitale; vertebra e qafës së mtrës, krahërorit dhe mesit; sacrum; coccyx; legen i plotë me simfizë; dhe kokat e levizshme të femurit. Modeli gjithashtu përmban paraqitje të arterieve vertebrale, degëve të nervit kurrizor dhe një disku intervertebral L3-L4 të prolapsuar. Montuar në një stendë për t'u varur. Madhësia: 85 cm, Peshë: përafërsisht. 2.9 kg		Copë	4	98.00	392.00
47	Dinamometri hidraulik i dorës Dinamometri Jamar Hand është projektuar si për kontrollin rutinë, ashtu edhe për fillestar dhe të vazhdueshëm të traumës së dorës ose duarve të sëmurë. rregullueshme mund të vendoset në pesë pozicione kapëse nga 35 në 87 mm. Ky sistem hidraulik i mbyllur përmban një shkallë të dyfishtë (paund dhe kilogram), e cila lexon forcën izometrike të kapjes nga 0 në 90 kg. Treguesi i forcës maksimale mbetet pas çdo leximi deri në rivendosjen. Dinamometri i dorës Jamar është praktikisht i papërkshueshëm nga rrjedhjet hidraulike dhe dizajni izometrik siguron rezultate të sakta, të riprodhueshme dhe vite shërbimi të besueshëm. Dinamometri i dorës Jamar është ndërtuar për të qëndruar; një kapak gome rezistente ndaj goditjeve mbrojtës prej çeliku inox dhe një rrip dore parandalon dëmtimin aksidental nëse bie. Përfshin udhëzimet, normat, certifikatën e kalibrimit dhe çantën mbajtëse; Rekomandohet kalibrimi vjetor; Me garanci për një vit të plotë. Garancia nuk mbulon kalibrimin.	 vlerësimin Doreza e	Copë	4	75.00	300.00
48	Peshore mekanike me mates gjatesie Specifikimet teknike Kapaciteti: 200 kg Ndjeshmëria: 100 g Madhësia: 435 x 1485 x 565 mm Peshë: 15.3 kg Platforma: 375 x 275 mm Madhësia e paketimit: 1490 x 495 x 155 mm"		Copë	4	125.00	500.00
49	Matësi i pikut të rrjedhës Mjeti për ushtrimin e frymëmarrjes PulmoGain rekomandohet për të ruajtur ose përmirësuar e frymëmarrjes tek njerëzit me probleme akute të frymëmarrjes, pacientët me sëmundje pulmonare obstruktive kronike dhe pacientët e shtrirë në shtrat. Mjeti për ushtrimin e frymëmarrjes PulmoGain përmirëson simptomat e dispnesë dhe ofron cilësi më të mirë të frymëmarrjes. Mjeti ushtrues i frymëmarrjes PulmoGain mund të shpërbëhet plotësisht për pastrim të brendshëm. zëvendësues është i përfshirë në paketim. Notat: E kuqe: (600cc/sek) E verdha: (900cc/sek) E gjelbër: (1200cc/sek).	 funksionin një filtër	Copë	4	35.00	140.00
50	Skollometer Instrument plastik për vlerësimin e skoliozës shytylës kurrizore në planin anësor, majtas dhe djathtas).	 (devijimi I	Copë	5	48.00	240.00
51	Jastek balancimi jastek balancimi stërvitje i mbushur me ajër - i bërë nga rutoni i cilësisë së lartë. Materiali Ruton është pa erë dhe shumë elastik (deri në rreth 200 kg). Produktet janë pa latex. Për origjinalin Dynair Ballkissen XXL Niveli III, Meditimi dhe Niveli IV TOGU Jep një garanci 30-vjeçare nga prodhuesi. Përmasat: 50 cm diametër Peshë: përafërsisht. 2.500 g Kapaciteti i ngarkesës: përafërsisht. 200 kg		Copë	4	25.00	100.00
52	Top trajnimi Thera-band GRIPBALL Për terapinë e duarve dhe gishtave GRIPBALL blu GRIPBALL e verdhë GRIPBALL e kuqe GRIPBALL e zezë (set)		Copë	4	15.00	60.00
53	Pranga Ushtrimi KUJDESI NE SHTEPI PER KUJDESIN NE SHTEPI PER DORËT DHE KYÇIN 0.5 KG KUJDESI NE SHTEPI PER KUJDESIN NE SHTEPI PER DORËT DHE KYÇIN 1 KG KUJDESI NE SHTEPI 2 KG PESHAT E DORËVE DHE KYÇVE 2 KG KUJDESI NE SHTEPI PER KUJDESIN NE SHTEPI PER DORËT DHE KYÇIN 3 KG	 (set)	Copë	5	25.00	125.00
54	Spiral horizontal për pro-supinimin e parakrahut dhe të dorës dimensionet: 40 x 22 x 30 cm"		Copë	2	18.00	36.00
55	Spirale vertikale për përdredhje dhe pro-supinim të dorës dhe krahut dimensionet: 40 x 18 x 30 cm"		Copë	4	28.00	112.00

56	Karroçë për pajisje mjekësore Karroca e instrumenteve 2 rafte Struktura kryesore prej çeliku inox 304 2 raftë fikse Doreza me shtytje Parakolp mbrojtës në katër qoshe 4 rrota me frenë kryq		Copë	4	145.00	580.00
KABINETIN E FIZIOTERAPISË						29,827.00

Kompletimi i Kabinetit të Teknologjisë Ushqimore

Nr	Artikulli	Njësia	Sasia	Çmimi pa TVSH	ÇMIMI
1	Dollap me dimensione 295 x 60cm me lartësi 90 cm - materiali mediapan-modeli të jetë sipas kërkesës së laborantët Dollapi i punuar nga iverali rezistent ndaj lagështisë 19 mm, të gjitha skajet të mbrojtura me shiritin ABS 0,8 mm RAL 7047. Dera e punuar nga polikarbonati i vendosur në kornize ABS. Brenda dollapit raftit nga iverali rezistent ndaj lagështisë i mbrojtur me shirit ABS 0,8 mm në të katër anet. Dorezat ergonomike nga plastika ABS RAL 7047 me hyrje identifikuese. Pjesa e pasme nga mediapani 2 mm mveshur në të dyja anet me folje melamine, RAL 7047. EN 13150	copë	1	278.00	278.00
2	Raft me dimensione 295 x 30cm, me lartësi 140 cm -materiali mediapan-modeli të jetë sipas kërkesës së laborantët Raftë të bëhen nga pllaka fibrash me densitet të mesëm të laminuar (MDF) me trashësi 18 mm. Skajet e kabinetit dhe kapakut janë bërë PVC të ngurtë 2mm EN 13150	copë	1	175.00	175.00
3	Dollap ventilimi me dimensione 100 x 70 cm, me lartësi 230 cm - materiali mediapan - modeli të jetë sipas kërkesave nga laborantët, në të të përfshihet edhe aspiratori për ventilim.Dollapët të bëhen nga pllaka fibrash me densitet të mesëm të laminuar (MDF) me trashësi 18 mm. Skajet e kabinetit dhe kapakut janë bërë PVC të ngurtë 2mm EN 13150	copë	1	145.00	145.00
4	Tavolinë e punës, 450 cm x 60 cm, me lartësi 90 cm, në të cilën vendosen pajisjet si frigoriferi,raftet etj.PANEL POSTFORMIK I LAMINUAR – Siperfaqja punuese nga laminati kompakt, trashësia 2 cm brendësia nga material rezistent ndaj lagështisë, siperfaqja rezistente ndaj solventeve dhe bakterieve, antistatik dhe vetshuaret me vijen/te çaren skajore Konstrukzioni i tavolines i punuar nga gypat e çelikut 50x50 dhe 50x30 deri 90 mm, me bartje të peshes 300 kg/m2, i zinkuar dhe plastifikuar me pluhur epoxy RAL 7047 rezistent ndaj acideve. Sistemi i nivelizimit të kembeve për pastrim dhe mirembajtje të lehte (e përshtatshme për dhomë të pastër). Perforcuesit diagonal metalik për stabilitet me të lartë të tavolines. EN 13150 Hapja e dollapëve vendoset në koordinim me komisionin e pranimit të Shkollës	copë	1	320.00	320.00
5	Tavolina 250 cm x 60 cm, me lartësi 75cm, materiali mediapan PANEL POSTFORMIK I LAMINUAR – Siperfaqja punuese nga laminati kompakt, trashësia 2 cm brendësia nga material rezistent ndaj lagështisë, siperfaqja rezistente ndaj solventeve dhe bakterieve, antistatik dhe vetshuaret me vijen/te çaren skajore Konstrukzioni i tavolines i punuar nga gypat e çelikut 50x50 dhe 50x30 deri 90 mm, me bartje të peshes 300 kg/m2, i zinkuar dhe plastifikuar me pluhur epoxy RAL 7047 rezistent ndaj acideve. Sistemi i nivelizimit të kembeve për pastrim dhe mirembajtje të lehte (e përshtatshme për dhomë të pastër). Perforcuesit diagonal metalik për stabilitet me të lartë të tavolines. EN 13150	copë	1	280.00	280.00
6	Tavolina pune për laborator 150 cm x 100 cm, me lartësi 100 cm - materiali mediapan PANEL POSTFORMIK I LAMINUAR – Siperfaqja punuese nga laminati kompakt, brendësia nga material rezistent ndaj lagështisë, siperfaqja rezistente ndaj solventeve dhe bakterieve, antistatik dhe vetshuaret me vijen/te çaren skajore Konstrukzioni i tavolines i punuar nga gypat e çelikut 50x50 dhe 50x30 deri 90 mm, me bartje të peshes 300 kg/m2, i zinkuar dhe plastifikuar me pluhur epoxy RAL 7047 rezistent ndaj acideve. Sistemi i nivelizimit të kembeve për pastrim dhe mirembajtje të lehte (e përshtatshme për dhomë të pastër). Perforcuesit diagonal metalik për stabilitet me të lartë të tavolines. EN 13150	copë	2	225.00	450.00
7	Peshore analitike Lexueshmëria (mg) 0.1 mg Pesha minimale (mg) 0.4 mg Koha e qëndrueshme së Ekran LCD (drita e pasme e gjelbër me font të zili) Madhësia e tavës Ø80 mm Temperatura e funksionimit 5-25°C Afërsia për të përsëritur 0.1 mg Nëse peshas220g 0.3 mg nga 220 g në 310 g 0.35 mg nga 310 g në 610 g Lineariteti ± 0,5 mg Madhësia e mburojës draft 162mm×171mm×225mm Kalibrimi i peshës së jashtme (të brendshme). Opsioni RS232C (Standard)/RS485/Printer (Opsionale) Dimensioni 345×215×345mm Dimensioni i paketimit 510×400×720mm	copë	1	288.00	288.00
8	Banjo ujore Kapaciteti 5 LIT Temp.Rangu i kontrollit RT. +5 ~ 100 °C Kohëmatësi 1min~99h59min Temp. Saktësia ±0,3°C Temp. Uniformiteti ±0,3°C (37°C) Alarmi i nivelit të lëngjeve Po Tensioni AC100~120V/AC200~240V 50~60Hz	copë	1	175.00	175.00
9	Ekonomik (pajisje për analizat e qumështit) përdorim dhe mirëmbajtje, lëvesueshëm dhe i automatizuar; Analiza e shpejtë dhe me kosto të ulët; Nuk përdoren acide ose kimikate të tjera; Kërkohet një sasi shumë e vogël qumështi; Centrifugë laboratorike 18 vende Kontroll elektronik me ekran dixhital të shpejtësisë dhe kohës, me nxitim dhe frenim rampa Kohëmatësi i kontrollueshëm nga 1' deri në 60' ose funksionim i vazhdueshëm. Motori i varur prej gome që garanton një funksionim të qetë. Ekran dixhital i shpejtësisë. Butoni i pulsit, që drejton motorin ndërsa shtypet.	copë	1	90.00	90.00
10	Përzlerse magnetike Pllaka e punës Dimensioni Φ120mm Materiali i pllakës së punës PET Ujji i motorit Motor DC pa furçë Pozicionet e trazimit 1 Maks. sasia e përzlerjes (H2O) 1,5 L Maks. shirit magnetik [gjatësia] 40 mm Gama e shpejtësisë 300-2000 rpm Shkalla e vendosjes së shpejtësisë Klasa e mbrojtjes IP21 Fuqia dalëse e motorit 1,2 W Fuqia 7,2 W Tensioni 100-120/200-240V,50/60Hz Dimensioni [W×D×H] 150×145×50mm Pesha 0.3 kg Temperatura dhe lagështia e lejuar e ambientit 5-40°C, 60% RH	copë	1	280.00	280.00
11	Furrë për djegjen e përbërësve organik (temp. deri në 1200 C) Furrat e hirit dhe djegies 13 liter Temperatura maksimale e funksionimit 1100OC ose 1200OC Ideale për hedhjen e mostrave më të mëdha me hi ose për të punuar me kavanoza jo standarde Uniformitet i mirë dhe kompensim për humbjen e nxehtësisë nga plaga e telit të klasifikuar	copë	1	145.00	145.00
12		copë	1	228.00	228.00


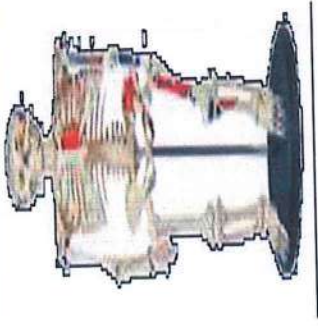
13	Rubineti 1 për lavaman dhe 1 që lidhet me destilator	copë	2	90.00	180.00
14	Pipeta sterile me vëllim 1ml, 5ml dhe 10ml Pipeta serologjike Hawach me majë të shtrirë është bërë kryesisht nga polistiren dhe material qelq. Dhe të gjitha madhësitë e pipetës serologjike, si 1ml, 5ml dhe 10ml, përdoren shpesh për matjen e një vëllimi të caktuar lëngu dhe duhet të përdoren me një pipetë të përshatshme.	copë	30	8.00	240.00
15	Lavaman Lavamani prej çeliku inox është rezistent ndaj temperaturave deri në 250 gradë Celsius, goditjeve termike dhe ndikimeve. Çelik inox i përdorur në prodhimin e lavamanëve përmban 18% krom, i cili është përgjegjës për rezistencën e lartë kimike, dhe 10% nikel, i cili siguron fleksibilitet shtesë. Ky kombinim jep një ngjyrë të këndshme, elegante dhe të pandryshueshme. Inox pastrohet lehtë, siguron një nivel të lartë higjienë, largon mikroorganizmat antiseptikë nga sipërfaqja, garanton një nivel të lartë të higjienës dhe pastrohet lehtë.	copë	1	75.00	75.00
16	Ngrohës i ujit Kapaciteti: nga 20 - 40 l Materiali: Plastikë Tregues i nivelit të ujit Filter kundër gurëzimit Hapje e kapakut Rrotullim 360° Ndalje automatike Ngjyra: E bardhë	copë	1	25.00	25.00
17	Pllakë me furë elektrike Klasa energjisë: A Kapaciteti i furës: 66 L 6 Funksione Ventilator 4 sipërfaqje te ngrohjes Paneli i kontrollit: Mekanik Përmasat: 85x60x60cm	copë	1	120.00	120.00
18	Frigorifer Frigorifer i kombinuar (montues) Kapaciteti neto: 175 L Kapaciteti i frigoriferit: 156 L Kapaciteti i fritt: 19 L Klasa energjisë: E Shpenzimet e energjisë: 152 kWh/vit Përmasat: 121.5x54x54.5 cm Niveli i zhurmës: 35 dB	copë	1	380.00	380.00
19	Bireta 50ml Prodhuar me xham borosilikat 3.3 të cilësisë së lartë dhe i kalibruar për të ofruar (TD, Ex). Numri i grupit është të shtypura në çdo biretë. Në përputhje me ISO 385, USP dhe "Eichordnung". Përputhshmëria me "Eichordnung" është e certifikuar përmes "H" zyrtare gjermane. nënshkruaj në çdo biretë sipas DIN 12600. Certifikata e grupit të përfshirë	copë	5	25.00	125.00
20	Perde për dritare 445 cm (perde qe sherbejne per mbulueshmerine e drites per kabinet)	metër	4.5	17.00	76.50
21	Magnet për përzierse magnetike PANELI I KONTROLLIT 1. Ekran dixhital që tregon shpejtësinë ose temperaturën e përzierjes. 2. Shtypni butonin, përzgjedhësin e parametrevë, shpejtësinë e trazimit ose temperaturën. 3. Shtypni butonin, rrisni vlerën e parametrut. 4. Shtypni butonin, ulni vlerën e parametrut. 5. Llamba treguese, termostati i siguriës "ndeaur" 6. Shtypni butonin Stop-Start Saktësia ±2 °C. - PËRFSHIREN Shufra mbajtëse me fije 12 mm Ø x500 mm i lartë, i varur nga përzierësi, i bashkëngjitet kryesores trupit i trazuesit. Sensori i temperaturës Pt100. Kontrollon temperaturën e njëjtë në trazuesit dixhitalë të pllakës së nxehtësisë. Sonda e zhytjes: 4mm Ø x 130 mm e gjatë. Lidhës kablo 150 cm e gjatë. Kapëse me kokë, Chrome "AUTOMATIC". allazh i veshur me mbijleje me vidë. Për Ø nga 0 në 25 mm	copë	4	287.00	1,148.00
22	Karrika për laborator të përshatshme me lartësinë e tavolinave punuese Kjo është një karrike poliuretani, shumë rezistente ndaj kimikateve. Ideale për të gjitha aplikimet industriale, duke përfshirë punishtet dhe fabrikat që përdorin kimikate (vaj, yndyrë, ujë). Materiali: shkumë poliuretani. Opsionit: rrota. përshatshëm për: laboratorë, dyqane, qendra shëndetësore. Lartësia e karriges: 860-1030 mm 920-1150 mm Lartësia e sediljes: 450-590 mm 510-700 mm Lartësia e krahut: nuk zbatohet Gjerësia e sediljes: 450 mm Thellësia e sediljes: 400-440 mm Gjerësia e pasme: 450 mm Baza: 600 mm Veshja (mbrapa dhe sedilja): PUR (poliuretani) Certificate ates PN-EN 1335-1 2004 PN-EN 1335-2 2009 PN-EN 1335-3 2009	copë	15	158.00	2,370.00
TOTAL - Kompletimi i Kabinetit të Teknologjisë Ushqimore					7,593.50



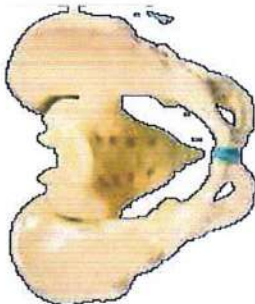
Kompletimi i Laboratorit të Kimisë



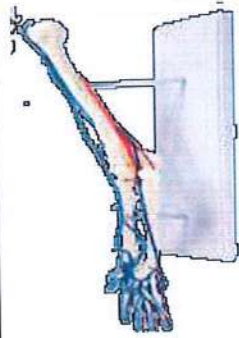
Nr	Artikulli	Njësia	Sasia	Çmimi pa TVSH	ÇMIMI
1.1	Dollap me dimensione 295 x 60cm me lartësi 90 cm - materiali mediapan-modeli të jetë sipas kërkesave nga laborantët. Dollapi i punuar nga iverali rezistent ndaj lagështisë 18 mm, të gjitha skajet të mbrojtura me shiritin ABS 0,8 mm RAL 7047. Dera e punuar nga polikarbonat i vendosur në kornize ABS. Brenda dollapit rafti nga iverali rezistent ndaj lagështisë i mbrojtur me shirit ABS 0,8 mm në të katër anet. Dorezat ergonomike nga plastika ABS RAL 7047 me hyrje identifikuese. Pjesa e pasme nga mediapan 2 mm mveshur në të dyja anet me folje melamine, RAL 7047. EN 13150	copë	4	278.00	1,112.00
1.2	Raft me dimensione 295 x 30cm, me lartësi 140 cm -materiali mediapan-modeli të jetë sipas kërkesave nga laborantët. Raftë të bëhen nga pllaka fibrash me densitet të mesëm të laminuar (MDF) me trashësi 18 mm. Skajet e kabinetit dhe kapakut janë bërë PVC të ngurtë 2mm EN 13150	copë	4	175.00	700.00
1.3	Dollap ventilimi me dimensione 100 x 70 cm, me lartësi 230 cm - materiali mediapan -modeli të jetë sipas kërkesave nga laborantët, në të të përfshihet edhe aspiratori për ventillim.Dollapët të bëhen nga pllaka fibrash me densitet të mesëm të laminuar (MDF) me trashësi 18 mm. Skajet e kabinetit dhe kapakut janë bërë PVC të ngurtë 2mm EN 13150	copë	4	145.00	580.00
1.4	Tavolinë pune me dimensione 590 cm x 70 cm, me lartësi 90cm- materiali i raftit mediapan, materiali i pllakës punuese të jetë material rezistent ndaj lagështisë ,nxehtësisë dhe acideve. pllakë e forte fiziko-kimike PANEL POSTFORMIK I LAMINUAR -- Sipërfaqja punuese nga laminat kompakt, brendësia nga material rezistent ndaj lagështisë, sipërfaqja rezistente ndaj solventeve dhe bakterieve, antistatik dhe vetshuare me vijën/te çaren skajore Konstrukcioni i tavolines i punuar nga gypat e gelikut 50x50 dhe 50x30 deri 90 mm, me bartje të peshe 300 kg/m2, i zinkuar dhe plastifikuar me pluhur epoxy RAL 7047 rezistent ndaj acideve. Sistemi i nivelizimit të kembeve për pastrim dhe mirembajtje të lehtë (e përshatshme për domo te pastër). Perforcuesit diagonal metalik për stabilitet me të lartë të tavolines. EN 13150	copë	4	320.00	1,280.00


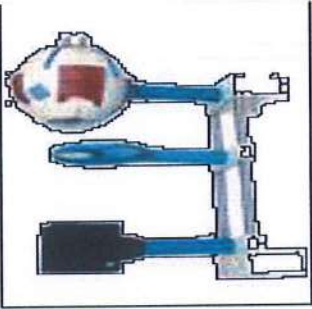
1.5	Tavolina pune për laborator 200 cm x 100 cm, me lartësi 100 cm - materiali median PANEL POSTFORMIK I LAMINUAR – Siperfaqja punuese nga laminati kompakt, brendësia nga material rezistent ndaj lagështisë, siperfaqja rezistente ndaj solventeve dhe bakterieve, antistatik dhe vetshuare me vijën/te çaren skajore Konstrukcioni i tavolinës i punuar nga gypat e çelikut 50x50 dhe 50x30 deri 90 mm, me bartje te peshes 300 kg/m ² , i zinkuar dhe plastifikuar me pluhur epoxy RAL 7047 rezistent ndaj acideve. Sistemi i nivelimit te kembeve per pastrim dhe mirembajtje te lehte (e pershtatshme per dhorne te paster). Perforcuesit diagonal metalik per stabilitet me te larte te tavolinës. EN 13150	copë	4	280.00	1,120.00
1.6	Mantile pune me madhësi (M,L,XL) te jeet nga materjali 75%polyester dhe 25% viscose180g/m ² dhe me susta perpara dhe me gjepa ngjyra vendose nga menagjer kontrates	copë	30	18.00	540.00
1.7	Dyer Standarte (90x210cm) Jan nga materjali median dhe korniza deres po ashtu me material median dhe aksesort doreza dhe bagllamte	copë	4	128.00	512.00
1.8	Ullambë UV Ullambë ultraviolet për analizën e gjendjes së lëkurës. Përmasat 30 x 21 x 7 cm. Tensioni i funksionimit: 220-240 V, 50/60 Hz.	copë	4	45.00	180.00
1.9	Drita zmadhuese LED e tavolinës Mimsal Lupa me 5 dioptra përfshin një zmadhim me 5 dioptra dhe është projektuar posaçërisht për të siguruar dritë të bardhë LED pa hije. Ai përmban një krah të artikuluar për manovrim të lehtë. Karakteristikat teknike të dritës zmadhuese LED të tavolinës Mimsal Lupa me 5 dioptra: Lloji i dritës: 60 LED - HF 6 W. Dioptri: 5. Thjerrëza: Ø 12.7 cm. Temperatura e ngjyrës: 6.500 °K. Tensioni i funksionimit: 110-230 V - 50/60 Hz. Klasa I. Standardet: 93/42/CEE. Jetëgjatësia e llambës: 40.000 orë.	copë	20	25.00	500.00
2	Peshore analitike Ekran dixhital me 7 segmente. Koha për stabilitet: 8 sekonda. Koha e rregullueshme dhe kontrolli i ndjeshmërisë. ON/OFF rregullimi automatik i zeros. Kalibrim manual i jashtëm 220 g. Gama e tarit me zbritje deri në kapacitetin maksimal. Funksioni i numërimit të pjesëve. Matja e dendësisë në bazën e njësish. Njësitë matëse në g, ct dhe oz. Rregullimi i nivelit (fluska). Ndërfaqja e të dhënave: RS-232 për lidhje me një printer. Temperatura e ambientit të operueshme 5 deri në 40 °C Furnizimi me energji elektrike: 110/220 V-50/60Hz. Furnizohet i kompletuar me kapak.	copë	4	288.00	1,152.00
2.1	Banjo ujore 12 liter kontrolla digjitale dhe shpall e temperatures dhe kohe shum te regullushme e tmperature se ambientite +5 °C deri në 200 °C. Rezervuari i dyfishtë prej çeliku inox AISI 304 me një kuti e jashtme prej çeliku inox AISI 304. Elementet ngrohëse të ngulitura në nxehtësinë INCOLOY dhe çelik inox rezistent ndaj korrozionit. Vjen i kompletuar me rubinet kullimi PANELI I KONTROLLIT Ndërprerës i përgjithshëm me llambë sinjalizuese. 1. Treguesit e ngrohjes; termostat i hapur; dështimi. 2. Ekran i leximit (temperatura ose koha).	copë	4	175.00	700.00
2.2	Lavaman Siperfaqja punuese dhe enet e lavamanit nga inoks teknike, rezistent ndaj acideve, kriperave dhe solventeve. Absorbimi minimal i ujit, stabiliteti termik, qe nuk ndizet dhe pa konduktivitet (perqeshmeri). Skajet e ngritura.	copë	4	75.00	300.00
2.3	Ngrohës i ujit Kapaciteti: nga 20 - 40 l Materiali: Plastikë Tregues i nivelit të ujit Filter kundër gurëzimit Hapje e kapakut Rrotullim 360° Ndalje automatike Ngjyra: E bardhë	copë	4	25.00	100.00
2.4	Kalkulator shkencorë Ekran me dy rreshta që shfaq deri në 12 shifra. Konvertim i këndeve nga gradë në gradian. Gjeneron kode QR për ndarje të lehtë të të dhënave. Përfshin një port USB për lidhje dhe transferim të të dhënave. Peshon vetëm 100g, duke e bërë atë të lehtë për ta mbajtur dhe transportuar.	copë	20	10.00	200.00
2.5	Rubineti 1 për lavaman dhe 1 që lidhën me destilator	metër	20	17.00	340.00
2.6	Perde për dritare 1230cmx170 cm				
2.7	Syze mbrojtëse kundër rrezeve UV Prezantimi i gjeneratës së re të syzeve mbrojtëse UVC. Ato përdoren për të mbrojtur sytë nga rrezet UVC. Drita mikrovrasëse ultravjollcë është e rrezikshme për sytë dhe me syzet e regjistruara nga FDA (#3008421850) dhe deri në kodin ANSI Z87, ato janë syzet kryesore ku mund të mbështeteni për të mbajtur sytë tuaj të sigurt. Sytë janë ato që duhen mbrojtur kur punoni me dritë UVC. Kur kërkon syze për të mbrojtur sytë tuaj, ngjyra portokalli është mburoja më e mirë pasi është projektuar posaçërisht për të bllokuar rrezet UV në intervalin 180-380 nm. Ullambat tona UVC lëshojnë në gjatësinë e valës mikrovrasëse prej 253.7 nm dhe këto gota do ta bllokojnë atë. Të prodhuara me humbje kundër mjegullës super të veshura, ato janë të lara, rezistente ndaj shenjave dhe antistatike. Të prodhuara me lente polikarbonate ato thithin 99.99% të çdo drite të dëmshme UV-A, UV-B dhe UV-C. Duke filluar nga 180-380 nm	copë	3	18.00	54.00
2.8	Bireta 50 ml Prodhuar me xham borosilikat 3.3 të cilësisë së lartë dhe i kalibruar për të ofruar (TD, Ex). Numri i grupit është të shtypura në çdo biretë. Në përputhje me ISO 385, USP dhe "Eichordnung". Përputhshmëria me "Eichordnung" është e certifikuar përmes "H" zyrtare gjermane. nënshkruaj në çdo biretë sipas DIN 12600. Certifikata e grupit të përfshirë	copë	10	25.00	250.00
2.9	Magnet për përzierje magnetike PANELI I KONTROLLIT 1. Ekran dixhital që tregon shpejtësinë ose temperaturën e përzierjes. 2. Shtypni butonin, përzgjedhësin e parametreve, shpejtësinë e trazimit ose temperaturën. 3. Shtypni butonin, rrisni vlerën e parametrut. 4. Shtypni butonin, ulni vlerën e parametrut. 5. Ullamba treguese, termostati i sigurtë "ndeaur" 6. Shtypni butonin Stop-Start Saktësia ±2 °C. PËRFSHIREN Shufra mbajtëse me fije 12 mm Ø x500 mm I lartë, i varur nga përzierësi, i bashkëngjitet kryesores trupit i trazuesit. Sensori i temperaturës Pt100. Kontrollon temperaturën e njëjtë në trazuesit dixhitalë të pllakës së nxehtësisë. Sonda e zhytjes: 4mm Ø x 130 mm e gjatë. Lidhës kablo 150 cm e gjatë. Kapëse me kokë, Chrome "AUTOMATIC". allazh i veshur me mbyllje me vidë. Për Ø nga 0 në 25 mm	copë	4	287.00	1,148.00
TOTAL - Kompletimi i Kabinetit të Kimisë					11,116.00

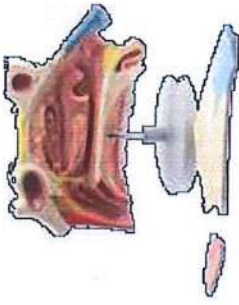
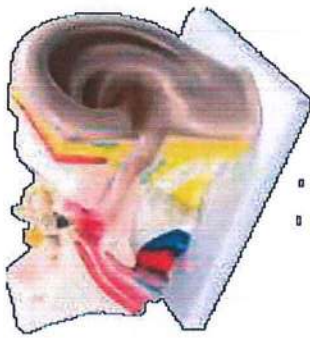
SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E BIOLOGJISE

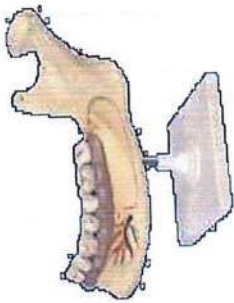
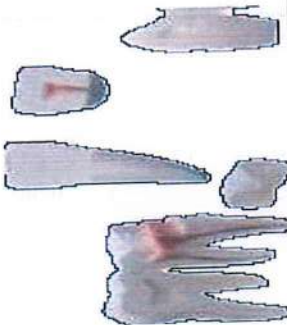
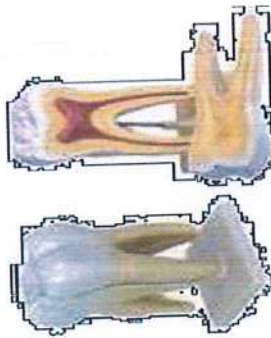
Nr.	Përshkrimi	Specifikimi teknik	Foto	Njësia matëse	Sasia	Çmimi per njësi	Çmimi total me TVSH
1	Skelet standard 170 cm	Dimensione: 170x46x29 cm Përshkrimi: Model i skeletit standard të njeriut 170 cm. Janë paraqitur 200 eshtra në madhësi natyrale, kafa në tri pjesë dhe dhëmbë të futur veçmas. Është i vendosur në një mbajtëse me bazament. Është bërë prej plastike		cop	10	278.00	2780.00
2	Skelet 85 cm	Dimensione: 85x20x13 cm Përshkrimi: Model i skeletit të njeriut 85 cm, i vendosur në një mbajtëse metalike me bazament plastik. Është bërë prej plastike		cop	10	47.50	475.00
3	Model skeleti 45 cm me vena dhe arterie	Dimensione: 45x20x13 cm Përshkrimi: Model i skeletit të njeriut 45 cm në të cilin jepen eshtrat e trupit dhe të karkës, kurse në anën e majtë të skeletit janë paraqitur venat dhe arteriet. Është bërë prej plastike, është vendosur në një mbajtëse me bazament		cop	10	47.50	475.00


4	Skelet 42 cm	Dimensione: 42x12x12 cm Përshkrimi: Model i skeletit të njeriut 42 cm, vendosur në një mbajtëse metalike me bazament plastik. Është bërë prej plastike		cop	10	38.00	380.00
5	Shtyllë kurizore elastike me kafkë dhe komblik	Dimensione: 144x18x12 cm Përshkrimi: Modeli e tregon strukturën e kockave të shtyllës kurizore, të kafkës dhe të komblikut. Është bërë prej plastike. Është vendosur në një mbajtëse me bazament		cop	10	38.00	380.00
6	Kafkë e një njeriut të rritur	Dimensione: 22x11x15 cm Përshkrimi: Model kafke i një njeriu të rritur në madhësi e pamje reale. Përbëhet nga dy pjesë. Është bërë prej plastike.		cop	10	42.50	425.00
7	Prezje e komblikut të mashkullit – femrës	Dimensione: 12x12x28 cm Përshkrimi: Model 3D i komblikut. Është bërë në dimensione sa gjysma e natyrales. Është bërë prej plastike, është vendosur në bazament metalik		cop	10	48.00	480.00

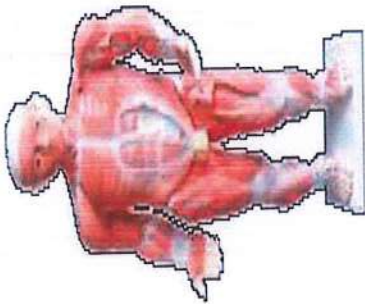
8	Truri i madh me arterie	Dimensione: 17x17x13 cm Përshkrimi: Model i trurit të madh me arterie, në madhësi e pamje reale. Përbëhet nga shtatë pjesë. Është bërë prej plastike.		cop	10	37.50	375.00
9	Një gjuri me ligamente	Dimensione: 25x15x15 cm Përshkrimi: Model i një pjese të kockës së kofshës dhe asaj të nën gjurit me ligamente të gjurit. Është bërë prej plastike.		cop	10	38.00	380.00
10	Këmbë me enët e gjakut	Dimensione: 98x13x15 cm Përshkrimi: Model këmbë i cili i përmban kockat e këmbës me nyjat e lëvizshme, venat dhe arteriet. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	65.00	650.00
11	Dorë me enët e gjakut	Dimensione: 64x14x15 cm Përshkrimi: Model dore me nyjën e venat dhe arteriet. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	62.00	620.00

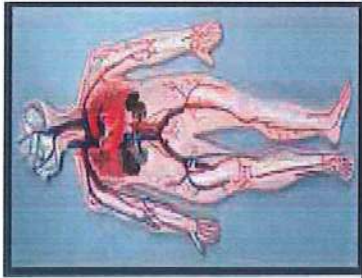
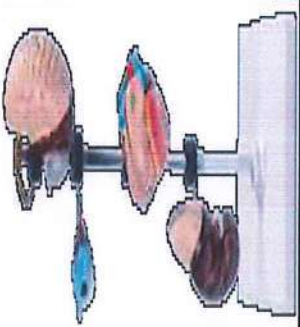
12	Syri	Dimensione: 14x9,5x10 cm Përshkrimi: Model syri i përbërë nga gjashtë pjesë. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike		cop	10	28.00	280.00
13	Model për demonstrimin e funksionimit të syrit të njeriut	Dimensione: 36x35x11 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga kokërdhoku i syrit – prerje horizontale dhe një thjerrëz fleksibël e cila lëviz nëpër shina metalike me mundësi fokusimi të një imazhi të caktuar. Pjesa e sipërme e syrit dhe struktura e brendshme mund të nxirren për t'u parë. Është bërë prej plastike.		cop	10	58.00	580.00

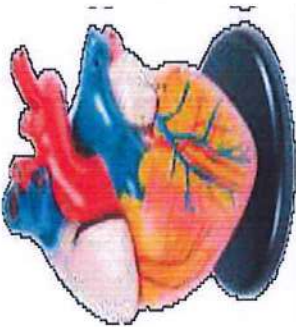
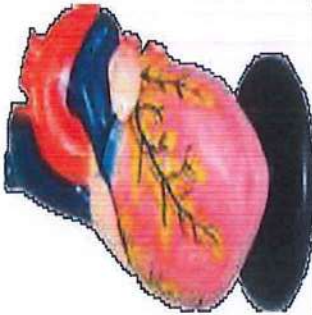
14	Model i zgavrës së hundës	Dimensione: 15x20x30 cm Përshkrimi: Model tri herë më i madh se madhësia normale ku janë paraqitur zgavra e hundës, septumi dhe guaskat e hundës. Një pjesë e epitelit mund të mënjanohet. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	37.50	375.00
15	Prerje e veshit	Dimensione: 32x20x20 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga pjesa e jashtme, e mesme dhe e brendshme e veshit (mund të ndahen veçmas kudhra dhe yzengjia). Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	35.00	350.00
16	Nofulla me dhëmbë dhe qielzë	Dimensione: 12x13x13 cm Përshkrimi: Model nofulle me dhëmbë dhe qielzë. Nofulla hapet e mbyllet për një vizualizim më të mirë. Është bërë prej plastike.		cop	10	38.00	380.00

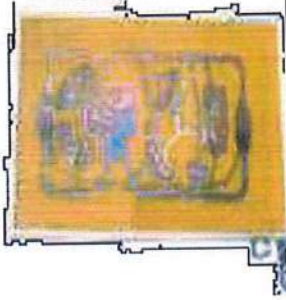
17	Model i nofullës së poshtme të majtë	Dimensione: 33x19x18 cm Përshkrimi: Modeli përfaqëson gjysmën (e majtë) e nofullës së poshtme, me pjesë që mund të hiqet që të mund të shihen rrënjët e dhëmbëve dhe nervat. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	47.50	475.00
18	Model dhëmbësh	Dimensione: Minimum 30x11x12 cm Përshkrimi: Set dhëmbësh: dhëmballë, dhëmbë prerës, dhëmb qeni. Çdo model dhëmbi është i përbërë nga dy pjesë në të cilat shihet prerja tërthore e dhëmbit. Është bërë prej plastike.		cop	10	42.00	420.00
19	Model dhëmballe me enë giaku dhe nerva	Dimensione: 16x20x32 cm Përshkrimi: Model dhëmballe i përbërë nga dy pjesë, në të cilat shihen enët e giakut dhe nervat e dhëmbit. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	10	38.00	380.00

20	Model fyti	Dimensione: 22x11x15 cm Përshkrimi: Modeli i fyti në madhësi reale i përbërë nga dy pjesë. Është bërë prej plastike		cop	10	38.00	380.00
21	Model lëkure	Dimensione: 25x23x4 cm Përshkrimi: Model i prerjes tërthore të lëkurës. Është bërë prej plastike.		cop	10	34.00	340.00
22	Trupi i njeriut – torzo 85 cm	Dimensione: 47x28x85 cm Përshkrimi: Model i një trupi të madh njerëzor (85 cm) në madhësi natyrore, i përbërë prej 18 pjesësh. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	270.00	2700.00
23	Trupi i njeriut – torzo 45 cm	Dimensione: 19x14x45 cm Përshkrimi: Model i një trupi të vogël njerëzor (45 cm) në madhësi natyrore, i përbërë prej 14 pjesësh. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike		cop	10	75.00	750.00

24	Muskulatura e trupit të njeriut 85 cm	Dimensione: 47x28x85 cm Përshkrimi: Model i trupit të njeriut (85 cm) në të cilin është paraqitur muskulatura e njeriut. Përbëhet prej 4 pjesësh ku tregohen muskujt sipërfaqësorë dhe ato të brendshëm, enët e gjakut dhe nervat. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike		cop	10	188.00	1880.00
25	Model njeriu – kukull për demonstrim dhe për ushtrime	Dimensione: 42x21x168 cm Përshkrimi: Model i dizajnuar në mënyrë speciale për trajnim profesional – praktik të infermiereve për kujdesin ndaj të sëmurit. Përfshin: larjen e kokës e të fytyrës, syve e veshëve, mirëmbajtjen e gojës dhe të zgavrës së hundës, frymëmarrje artificiale, vendosjen e infuzionit, mundësi për të bërë injeksione, transfuzion etj.		cop	5	390.00	1950.00

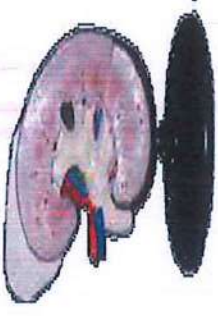
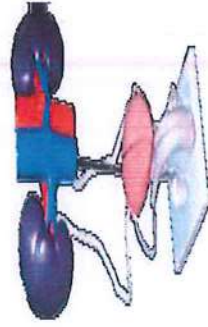
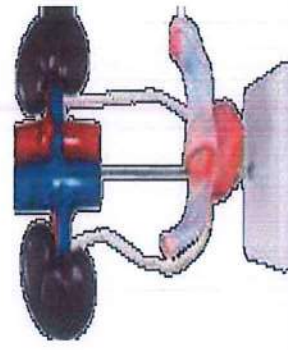
26	Sistmi i qarkullimit të gjakut	"Sistemi i qarkullimit të gjakut 1/2 madhësia e jetës Sistemi vaskular Tregon strukturën bazë të skeletit të njeriut  Zemra Mushkëritë Mëlçisë Shpretkë Veshkat e montuara në bazë Madhësia: 80*30*6cm"		cop	10	180.00	1800.00
27	Model hipertensioni	Dimensione: 38x12x12 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga gjysma e trurit, model i syrit, model i zemrës dhe model i veshkës të vendosura në një mbështetëse metalike. Është bërë prej plastike. 		cop	10	58.00	580.00


28	Zemër e re në 4 pjesë	Dimensione: 24x15x15 cm Përshkrimi: Model i një zemre të re të përbërë nga: arteria pulmonare dhe aorta, valvulat, muri ndarës i barkusheve, barkushja e majtë dhe ajo e djathtë dhe muskuli i zemrës. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	10	55.00	550.00
29	Zemër e madhe në 3 pjesë	Dimensione: 38x20x15 cm Përshkrimi: Në model janë treguar: arteria pulmonare dhe aorta, valvulat, muri ndarës i barkusheve, barkushja e majtë dhe ajo e djathtë dhe muskuli i zemrës.		cop	10	40.00	400.00

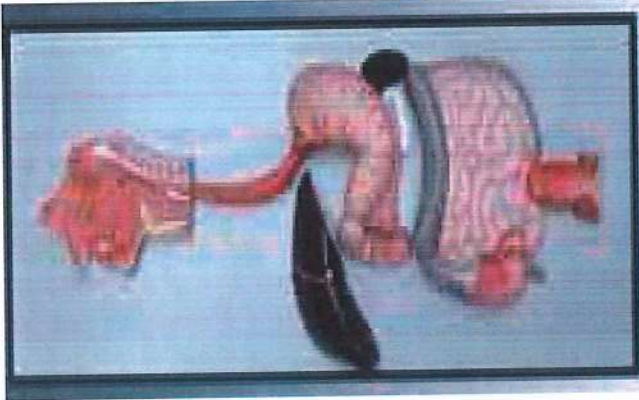
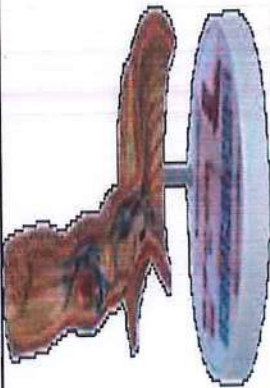
30	Model për demonstrimin e punës së zemrës dhe qarkullimit të gjakut	Dimensione: 41x17x71 cm Përshkrimi: Model elektrik për demonstrimin e qarkullimit të gjakut dhe të punës së zemrës. Zemra është bërë prej materiali elastik kështu që mund të demonstrohen rrahjet e zemrës, hapja dhe mbyllja e valvulave, ndërsa qarkullimi i gjakut është përfaqësuar me dritë të kuqe dhe të kaltër, d.m.th. arteriet dhe venat. Është bërë prej plastike. Punon me energji elektrike në 220 V, 50		cop	10	220.00	2200.00
31	Model për demonstrimin e qarkullimit të gjakut	Dimensione: 35x90x8 cm Përshkrimi: Model elektrik përfaqëson diagram të punës së zemrës dhe të qarkullimit të gjakut, ndërsa qarkullimi i gjakut është përfaqësuar me dritë të kuqe dhe të kaltër, d.m.th. venat dhe arteriet. Është bërë prej plastike. Punon me energji elektrike në 220 V, 50 Hz.		cop	10	220.00	2200.00


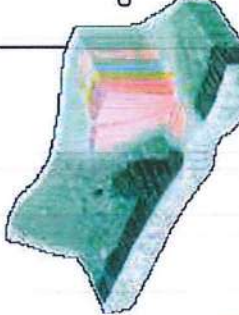
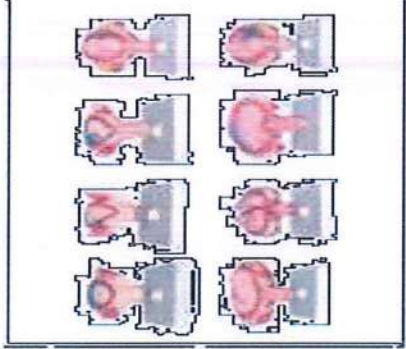
32	Demonstrues i mushkërive	Dimensione: 20x18x28 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga një enë qelqi në të cilën ka dy tullumbace në formë të mushkërive, nëpërmjet të cilëve merret një imazh vizual për punën e mushkërive. Është bërë prej qelqi dhe prej plastike.		cop	10	35.00	350.00
33	Mushkëri – transparente	Dimensione: 28x18x32 cm Përshkrimi: Model më i madh se madhësia reale ku duken "pema" bronkiale e të dy krahëve të mushkërive. Është i vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	10	78.00	780.00

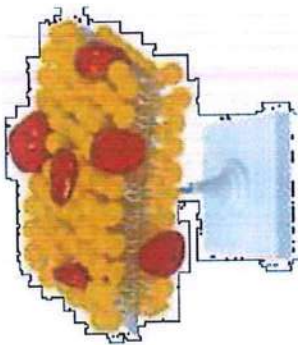
34	Model bronkiolo me alveola	Dimensione: 28x25x44 cm Përshkrimi: Model ku është paraqitur prerje e një pjese të bronkiolës në formën e veshit të rrushit, ku çdo kokërr rrushi i përfaqëson alveolat e mushkërive. Është bërë prej plastike ose material ekuivalent. Është vendosur në një bazament.		cop	10	37.50	375.00
35	Model për demonstrimin e funksionimit të sistemit respirator	Dimensione: 41x17x71 cm Përshkrimi: Model elektrik me të cilin demonstrohen frymëmarrja me lëvizjen e krahavorit me organet torakale dhe lëvizja e diafragmës. Është bërë prej plastike. Punon me energji elektrike 220 V, 50 Hz.		cop	10	225.00	2250.00

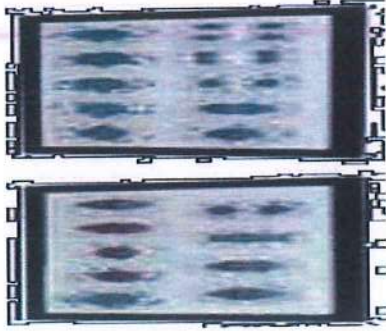
36	Preje e veshkës me gjëndrën limfatike	Dimensione: 30x20x12 cm Përshkrimi: Preje tërthore e veshkës me gjëndrën limfatike. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	10	38.00	380.00
37	Sistemi gjental urologjik mashkullor	Dimensione: 40x19x12 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga veshkat, fshikëza urinare, penisi dhe testikujt. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	10	47.50	475.00
38	Sistemi gjental urologjik femëror	Dimensione: 40x19x12 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga veshkat, fshikëza urinare, kanalet urinare, mitra me vezorët dhe ligamentet e mitrës me arteriet. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	45.00	450.00

39	Pankreasi (mëlçia)	Dimensione: 30x20x12 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga mëlçia dhe zorra Model i përbërë nga mëlçia dhe zorra dymbëdhjetëgjishtore. Përbëhet nga tri pjesë. Është vendosur në bazament. Është bërë prej plastike		cop	10	42.00	420.00
40	Stomaku	Dimensione: 30x20x12 cm Përshkrimi: Modeli përfaqëson prerje tërthore Modeli përfaqëson prerje të stomakut në gjendje gastritit. Përbëhet nga dy pjesë. Është bërë prej plastike.		cop	10	45.00	450.00

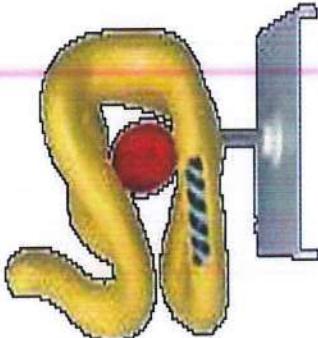
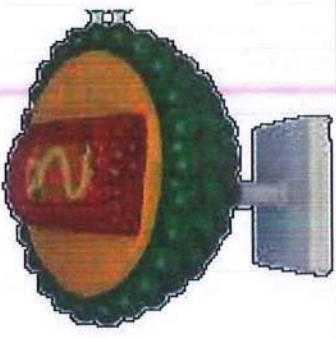
41	Sistemi i tretës	Modeli i sistemit tretës të njeriut Modeli i sistemit tretës të njeriut në madhësi reale, i cili demonstroi të gjithë sistemin tretës në lehtësim grafik. Karakteristikat e sistemit tretës: hunda, zëvra e gojës dhe faringu, ezofag, trakti gastrointestinal, mëlcia me fshikëzën e tëmthit, Pankreasi, shpretka. Duodeni, zorrët dhe rektumi i sistemit tretës duhet të hapet. Koloni tërthor dhe muri i përparmë i stomakut duhet të jenë të largueshëm nga sistemi tretës për studim të detajuar të anatomisë.		cop	10	225.00	2250.00
42	Modeli i zorrës së trashë	Dimensione: 14x10x19 cm Përshkrimi: Modeli përfaqëson prerje tërthore të zorrës së trashë, në madhësi normale. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	10	35.00	350.00

43	Modelle të ADN-së	Dimensione: 12x12x30 cm Përshkrimi: Modele të ADN-së në të cilat paraqitur dy vargje të ADN-së. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.	  	10	38.00	380.00
44	Model i fazave të zhvillimit të fetusit	Dimensione: 12x12x15 cm Përshkrimi: Set prej 8 modelesh të mitrës me fetus: 3 modele nga tre muajt e parë të zhvillimit të fetusit dhe 5 modele të zhvillimit të embrionit. Fetusi dhe embrioni mund të nxirren për t'u parë. Janë vendosur në një bazament. Janë bërë prej plastike		10	218.00	2180.00
45	Modeli i sistemit riprodhues femror	Përshkrimi:Modeli anatomik i mitrës me vezore		10	90.00	900.00

46		Modeli i sistemit riprodhues të njeriut mashkullor		cop	10	75.00	750.00
47	Modele të organeve qelizore	Dimensione: 27x20x17 cm Përshkrimi: Seti përmban: një model kloroplasti, një model të sistemit të Golxhit, një model mitokondrie dhe dy copë nga trupi i brendshëm dhe ai qendror. Është bërë prej plastike		cop	10	48.00	480.00
48	Model i membranës qelizore	Dimensione: 30x27x19 cm Përshkrimi: Model në të cilin janë paraqitur shtresa lipide bimolekulare dhe proteinat (të nglyrosura me të kuqe). Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	10	58.00	580.00


49	Model mitoze dhe mejoze	Dimensione: 40x50 cm Përshkrimi: Set prej dy modelesh të mitozës dhe mejozës me të cilat jepet ndarja e qelive të qelizave të kafshëve. I përshin fazat e mëposhtme: interfazë, profazë, profazë, para-metafazë, metafazë, anafazë, telofazë, citokinezë. Është bërë prej plastike.		cop	10	145.00	1450.00
50	Model qelize shtazore	Dimensione: 50x27x10 cm Përshkrimi: Prejje tërthore e qelizës shtazore. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike		cop	10	48.00	480.00
51	Autopsi e një bretkose	Dimensione: 38x35x15 cm Përshkrimi: Model 3D në të cilin është paraqitur autopsi e pjesës së barkut të një bretkose. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	10	48.00	480.00

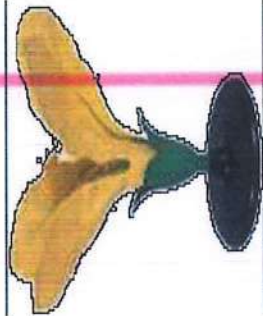
52	Pajisje për autopsi	Dimensione: 15x10x1 cm Përshkrimi: Seti përmban 2 lloje gërshërësh me dimension 12 cm, dy lloje thikash me dimension 12 cm, 2 lloje bizash me dimension 13 cm dhe dy lloje pincetash me dimension 12 cm, janë bërë prej metali.		cop	10	25.00	250.00
53	Hidra (set 2 modele	Dimensione: 39x15x15 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga dy pjesë – prej gjatësore dhe tërthore, ku tregohet struktura e brendshme dhe ajo e jashtme. Është vendosur në njëbazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	48.00	480.00
54	Paramecium	Dimensione: 20x38x10 cm Përshkrimi: Model organizmi njëqelizor. Përbëhet nga bërthama, vakuola- qerpiqet e kontaktit dhe të ushqimit. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	10	40.00	400.00

55	Model aminoacidi në zinxhirin polipeptid	Dimensione: 17x15x24 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e reaksionit kimik të aminoacidit – formimi i lidhjes peptide e cila mundëson lidhjen e dy aminoacideve dhe më tej formimin e zinxhirit polipeptid. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	42.00	420.00
56	Model i virusit të SIDA-s	Dimensione: 26x26x30 cm Përshkrimi: Model i zmadhuar një milion herë, përbëhet nga dy pjesë, ku janë paraqitur membranat e jashtme lipide me strukturë të proteinave dhe bërthama e brendshme e cila e përmban materialin e trashëgimisë virale.		cop	10	35.00	350.00

57	Kërcell i një bime një kotiledone	Dimensione: 10x40x40 cm Përshkrimi: Model i kërcellit të një bime një kotiledone, ku është paraqitur struktura qelizore e brendshme dhe e jashtme. Është bërë prej plastike.		cop	10	35.00	350.00
58	Kërcell i një bime dy-kotiledone	Dimensione: 16x33x20 cm Përshkrimi: Model i kërcellit të një bime dy-kotiledone, ku është paraqitur struktura qelizore e brendshme dhe e jashtme. Është bërë prej plastike		cop	10	35.00	350.00
59	Struktura qelizore e majës së rrënjës	Dimensione: 45x12x6 cm Përshkrimi: Model ku është paraqitur struktura qelizore e brendshme dhe e jashtme. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike		cop	10	35.00	350.00

60	Struktura e gjethes (model i madh)	Dimensione: 16x45x20 cm Përshkrimi: Në model janë paraqitur struktura e brendshme dhe e jashtme me: epidermën e sipërme dhe të poshtme, qelizat sfungjerore e rrethuese dhe indin vaskular. Është bërë prej plastike.		cop	10	35.00	350.00
61	Model i një qelize bimore	Dimensione: 38x12x12 cm Përshkrimi: Model i paraqet prerje tërthore reale të një qelize bimore. Është bërë prej plastike.		cop	10	35.00	350.00
62	Lule pjeshke	Dimensione: 20x27x27 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekët, petalet, gjethet e kupës (sepalet). Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike		cop	10	23.00	230.00

63	Model i lules së grurit	Dimensione: 38x19x9,5 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga dy modele: model i lules së grurit dhe model i luleve të kallirit të grurit. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	23.00	230.00
64	Model i lules së misrit	Dimensione: 12x12x23 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekët, petalet, gjethet e kupës (sepalet). Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	23.00	230.00
65	Model i lules së patates	Dimensione: 19x19x20 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekët, petalet, gjethet e kupës (sepalet). Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	23.00	230.00


66	Model i lules së tulipanit	Dimensione: 25x23x4 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekët, petalet, gjethet e kupës (sepalet). Pistili dhe thekët mund të hiqen për shqyrtim më të hollësishëm. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	23.00	230.00
67	Model i lules së lakrës	Dimensione: 20x20x28 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekët, petalet, gjethet e kupës (sepalet). Pistili dhe thekët mund të hiqen për shqyrtim më të hollësishëm. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	23.00	230.00
68	Model i lules së bizeles	Dimensione: 24x18x18 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekët, petalet, gjethet e kupës (sepalet). Pistili dhe thekët mund të hiqen për shqyrtim më të hollësishëm. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	10	23.00	230.00

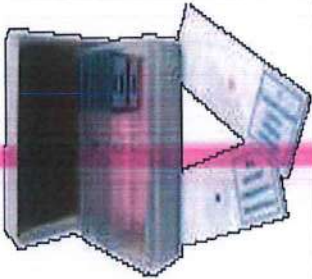
69	Model i prerjes së qepës	Dimensione: 17x13x23 cm Përshkrimi: Modeli përfaqëson prerje tërthore ku mund të shihen pjesët e qepës. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike		cop	10	23.00	230.00
----	--------------------------	--	---	-----	----	-------	--------

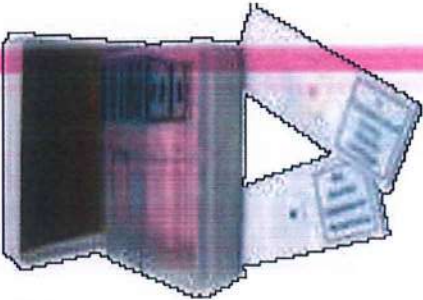
70	LCD mikroskop digital	Dimensione: 35x15x10 cm Përshkrimi: LCD mikroskop digital me zmadhim x50x500, zmadhim digital x2000 dhe rezolucion të kamerës 5 MP. Përbëhet nga një monitor LCD me ekran prej 3,5 inç (8,9 cm) sensor CMOS për shqyrtim të drejtpërdrejtë (fotografi dhe video) kokë rrotulluese me tre objektivë (x4, x10, x40), me ndriçim LED prej 230 V, një rrotë me gjashtë ngjyra të ndryshme për vëzhgim optimal, sipërfaqe precize për vëzhgim të objekteve. Pajisje shtesë: Kablo USB për vëzhgim të objekteve edhe në kompjuter, me çka mundësohet që në të njëjtën kohë vëzhgimin ta ndjekin më shumë persona.; kartë SD prej 1 GB; kuti me 10 diapozitiva bosh; 20	cop	5	580.00	2900.00
----	-----------------------	--	-----	---	--------	---------

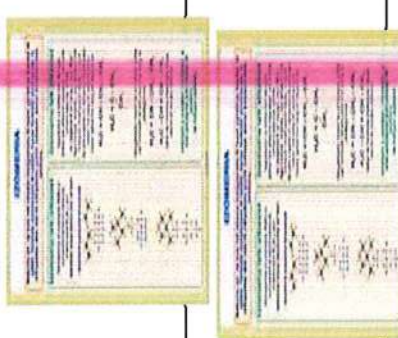
71	Mikroskop	Dimensione: 28x20x15 cm Përshkrimi: Zmadhimi maksimal x40 – x 1.600. Okular me zmadhim x10 dhe x15. Objektivat janë me 4, 10, 40, 100. Binokular nën kënd 45 gradë, me rrrotacion 360 gradë. Lamba për ndriçim prej 12 V/20W dhe 6V/20W. Rregullim i përafërt i fushëveprimit është 15 mm, kurse rregullimi më i imët është 1.6 mm. Sipërfaqja e punës 120x120 mm. Kondensator: NA 1,25 me diafragmë të ndryshueshme, peshore të lëvizshme dhe filtër.	cop	10	280.00	2800.00
----	-----------	---	-----	----	--------	---------



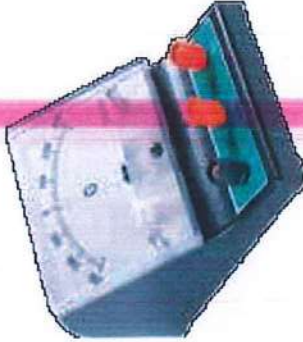
72	Mikroskop	Dimensione: 25x17x12 cm Përshkrimi: Zmadhimi maksimal x 40 – x 400. Objektivat janë me 4, 10, 40. Okularë me zmadhim 10 X. Monokular nën kënd 45 gradë, me rrotacion 360 gradë. Për ndriçim përdor diodë LED. Rregullim i përfaqësuesit të diapazonit është 15 mm.		cop	10	188.00	1880.00
73	Mikroskop	Dimensione: 23x13x10 cm Përshkrimi: Zmadhimi maksimal x 70 – x 150 x 400. Zmadhimi i thjerrëzave x7, x15, x40. Thjerrëza vëzhguese për zmadhim x10. Diapazoni i fokusimit 8 mm. Objektabela 90x86 mm.		cop	10	145.00	1450.00

74	Set mikroskopi	Përshkrimi: Set mikroskopi me zmadhim x50 – x1.200 dhe thjerrëza qelqi për vëzhgim preciz. Është përbërë nga 12 diapozitiva boshe, 5 diapozitiva me preparate, 10 qelqe për mbulim, 5 preparate të paketuara në tubeta plastike, gërrshërë, lupë, pinceta dhe gjiqpëra.		cop	5	225.00	1125.00
75	Preparate mikroskopike për anatomi	Dimensione: 2,5x7,5 cm Përshkrimi: Set prej 11 diapozitivash: funde nervore te lepuri, muskuj skeletorë te qeni, nylje limfatike, palcë kurrizore te lepuri, qeliza të epitelit, hidër, gjak njeriu, ind elastik kërcor, mitozë e qelizës bimore, pjesë e kockës së njeriut, ind lidhës. Paketuar në kuti.		cop	20	22.50	450.00


76	Preparete mikroskopike për botanikë	Dimensione: 2,5x7,5 cm Përshkrimi: Set prej 16 diapozitivash: polen luleje, pluhur, spirogira, myshk, fier, spore fieri, gjethë pishe, farë pishe, rrënjë misri, rrënjë fasuleje, monokotiledone dhe di-kotiledone (misër dhe lulëdielli), epidermë qepe, gjeth gruri, epidermë nga gjethja e fasules, farë zambaku, penicillium. Janë paketuar në kuti		cop	20	22.50	450.00
77	Preparete mikroskopike për zoologji	Dimensione: 2,5x7,5 cm Përshkrimi: Set prej 9 diapozitivash: paramaecium, hidër, shirt kau, parazit – ascaris, krimb shiu, molë, vezë bretkose, mitozë e qelizës shtazore, mejozë e qelizës shtazore.		cop	20	22.50	450.00
78	Xhama objektivi	Dimensione: 20x70x2 mm Përshkrimi: Në të vendosen objektet që duhet të vëzhgohen në mikroskop.		cop	20	12.00	240.00


79	Xhama mbulues	Dimensione: 20x20x0,5 mm Përshkrimi: Xham mbulues për mbivendosje të asaj që duam ta vëzhgojmë në mikroskop.		cop	20	15.00	300.00
80	Postera per Zoologji 100x70 cm	Dimensione: 100x70 cm Përshkrimi: Poster i është i plastifikuar në të dyja anët, i përforcuar me listela plastike.		Copë	50	13.00	650.00
81	Postera per anatomi	Dimensione: 100x70 cm Përshkrimi: Poster i është i plastifikuar në të dyja anët, i përforcuar me listela plastike.		copë	50	13.00	650.00
82	Postera	Postera te ndryshem nga Biologjia: Dimensione: 70x100 cm Spe c i f i k i m i teknik: Shtypur me ngjyra në letër 150 g/m2, i plastifikuar në të dyja anët, i përforcuar me listela plastike.		cop	50	13.00	650.00
TOTALI:							62,085.00


SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E FIZIKËS							
Nr.	përshkrimi	Specifikimi teknik	Foto	Njësia matëse	Sasia	Çmimi per njësi	Çmimi total me TVSH



1	Ampermetër	Dimensione: 10x10x13 cm Përshkrimi: Ampermetër, pajisje për matjen e intensitetit të rrymës, me diapazon të matjes 0,2 ~ 0~0,6 A; dhe ndjeshmëri 75 mV. Është bërë prej plastike		cop	5	25.00	125.00
2	Voltmetër	Dimensione: 10x10x13 cm Përshkrimi: Voltmetër, pajisje për matjen e tensionit elektrik, me diapazon të matjes 1~0~3V, 5~0~15V dhe ndjeshmëri 1mA. Është bërë prej plastike.		Copë	5	25.00	125.00
3	Galvanometër	Dimensione: 10x10x13 cm Përshkrimi: Galvanometër, pajisje për matje të rrymave të ulëta në qark elektrik, mund të matë dhe induksionin elektromagnetik, efektin fotoelektrik etj. Ka ndjeshmëri 300 µA. Është bërë prej plastike		cop	5	25.00	125.00


4	Multimeter	Multimeter DC Voltage 200m-2-20-200-1000V ±(0.5%+1dgt) AC Voltage 200m-2-20-200-750V ±(0.8%+3dgt) DC Current 2m-20m-200m-20A ±(0.5%+1dgt) AC Current 20m-200m-20A ±(1.0%+3dgt) Resistance 200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ ±(0.8%+1dgt) Capacitance 2n-20n-200n-2μ-20μ-200μF ±(4.0%+3dgt)				cop	15	78.00	1125.00
---	------------	--	---	--	--	-----	----	-------	---------



5	Bankë optike	Dimensione: 20x95x8 cm Përshkrimi: Për përcaktimin e gjerësisë së fokusit ndërmjet thjerrëzave, është e përbërë nga një shinë e graduar me rrëshqitës në të cilët është vendosur burimi i dritës, objekti, thjerrëza konvergjente dhe divergjente.		cop	5	80.00	400.00
6	Dinamometër 1 N	Dimensione: 18x18x3 cm Përshkrimi: Dinamometër (rrethor), pajisje për matjen e forcës deri në 1N. Përbëhet nga një tub i tejdukshëm dhe një sustë e hollë. Është bërë prej plastike.		cop	15	12.00	180.00
7	Dinamometër 5 N	Dimensione: 18x18x3 cm Përshkrimi: Dinamometër (rrethor), pajisje për matjen e forcës deri në 5 N. Përbëhet nga një tub i tejdukshëm dhe një sustë e hollë. Është bërë prej plastike.		cop	15	12.50	187.50

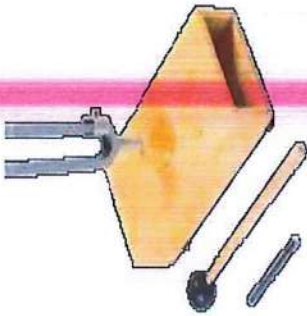

8	Dinamometë r 5 N i sheshtë	Dimensione: 18x4x1 cm Përshkrimi: Pajisje për matjen e forcës prej 5 N. Është bërë prej plastike		cop	15	12.80	192.00
9	Dinamometë r 10 N	Dimensione: 18x4x1 cm Përshkrimi: Pajisje për matjen e forcës prej 10 N. Është bërë prej plastike.		cop	15	13.00	195.00
10	Reostat i ndryshueshë	Dimensione: 32x8,5x14 cm Përshkrimi: Reostat i ndryshueshëm, rezistenca 0-20Ω +5 %. Rryma e punës 2 A. Është bërë prej metali dhe plastike.		cop	5	35.00	175.00
11	Demonstrues i Ligjit të I të Njutonit	Dimensione: 10x10x8 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e Ligjit të I të Njutonit. Është bërë prej plastike		cop	5	25.00	125.00




12	Demonstrues i Ligjit të II të Njutonit	Dimensione: 95x8x22 cm Përshkrimi: Përbëhet nga shina prej alumini dhe një karrocë plastike me hapje ku vendosen pesha për rritjen e masës gjatë realizimit të demonstrimit për të provuar Ligjin e II të Njutonit.		cop	5	75.00	375.00
13	Demonstrues i Ligjit të III të Njutonit	Dimensione: 18x7x11 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e Ligjit të III të Njutonit. Është bërë prej metali ose prej materialesh ekuivalente		cop	5	35.00	175.00
14	Elektroskop	20x10x33 cm Përshkrimi: Model për matjen e shkallës së zimit të trupave elektrike Është bërë prej plastike.		cop	5	45.00	225.00
15	Peshore fizike me pesha	Dimensione: 38x12x14 cm Përshkrimi: Model për matje precize të masave. Është bërë prej metali dhe plastike		cop	5	65.00	325.00

16	Generator manual	Dimensione: 35x25x20 cm Përshkrimi: Modeli shërben për të parë konstrukcionin dhe parimin e punës së gjeneratorëve AC/DC. Është bërë prej metali dhe plastike.		cop	5	75.00	375.00
17	Gjenerator trefazor	Dimensione: 15x15x14 cm Përshkrimi: Modeli shërben për të parë parimin e punës së gjeneratorit induktiv trefazor. Është bërë prej metali dhe plastike.		cop	5	78.00	390.00
18	Demonstrues i forcave magnetike	Dimensione: 18x18x21 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e drejtimit të veprimit të vijave të forcave magnetike në rastin e magnetit në formë shufre dhe atij në formë patkoi		cop	5	60.00	300.00
19	Demonstrues i fushës elektromagnetike	Dimensione: 18x18x21 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e drejtimit të veprimit të vijave të forcave magnetike dhe shpërndarja e rrymës në fushën magnetike.		cop	5	70.00	350.00


20	Magnet (shufër)	Dimensione: 75x15x20 mm Përshkrimi: Modeli është bërë prej çeliku të magnetizuar, është ngjyrosur me ngjyrë të kuqe dhe të kaltër, në formë shufre.		cop	30	10.00	300.00
21	Magnet (patkua)	Dimensione: 86x62x10 mm Përshkrimi: Modeli është bërë prej çeliku të magnetizuar, është ngjyrosur me ngjyrë të kuqe dhe të kaltër, në formë patkoi.		cop	30	10.00	300.00
22	Elektromagnet	Dimensione: 14x10x3 cm Përshkrimi: Modeli përbëhet prej dy bobinave të vendosura në një pjesë metalike në formë U-je dhe shërben për demonstrimin e parimit të punës së elektromagnetit.		cop	15	25.00	375.00
23	Gjilpëra magnetike	Dimensione: 10x6x6 cm Përshkrimi: Modeli përbëhet prej një gjilpëre magnetike të fiksuar në një bazament dhe e reflekton fushën magnetike në prani të një magneti në shufre apo patkoi.		cop	30	15.00	450.00

24	Autonjjet me energji diellore	Dimensione: 20x14x13 cm Përshkrimi: Modeli i cili shërben për shndërrimin e energjisë diellore në energji elektrike dhe mekanike. Është bërë prej plastike.		cop	5	45.00	225.00
25	Qella bazë	Dimensione: 8x5x10 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e parimit të punës së akumulatorit.		cop	5	35.00	175.00
26	Pajisje për bymimin e trupave gjatë ngrohjes	Dimensione: 26x3x7 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e byimit të trupave gjatë ngrohjes së tyre.		cop	5	28.00	140.00
27	Demonstrues i Ligjit të Paskalit	Dimensione: 15x15x14 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e Ligjit të Paskalit – veprimi i presionit të njëjtë në të gjitha drejtimet. Është bërë prej plastike.		cop	5	35.00	175.00

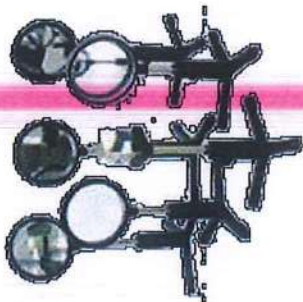
28	Rezonator – pirun 400 Hz	Dimensione: 24x19x10 cm Përshkrimi: Rezonator – pirun për të prodhuar valë zanore prej 400 Hz. Model nga kutia e rezonimit prej i përbërë rimesoje druri, piruni zanor dhe çekiçi i vogël i cili në njërin anë ka një top gome. Është bërë prej druri dhe metali.		cop	5	32.00	160.00
29	Konduktometër	Dimensione: 40x23x20 cm Përshkrimi: Modeli është i përbërë nga 5 metale të ndryshme: alumin, tunxh, çelik, nikël dhe bakër, të lidhur me një dorezë e cila në fund është prej druri		cop	5	35.00	175.00
30	Shufër ebaniti	Dimensione: Trashësia 1 cm dhe gjatësia 15 cm Përshkrimi: Shërben për studimin e elektricitetit dhe të elektrizimit të trupave. Është bërë prej ebaniti.		cop	15	10.00	150.00

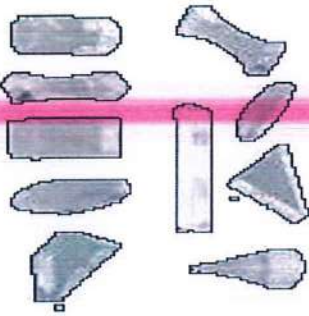
31	Shufër qelqi	Dimensione: Trashësia 1 cm dhe gjatësia 15 cm Përshkrimi: Shërben për studimin e elektricitetit dhe të elektrizimit të trupave. Është bërë prej qelqi. 	cop	15	10.00	150.00
32	Shufër polietileni	Dimensione: 30x4x3 cm Përshkrimi: Shërben për studimin e elektricitetit dhe të elektrizimit të trupave. 	cop	15	10.00	150.00
33	Shufër najloni	Dimensione: 30x4x3 cm Përshkrimi: Shërben për studimin e elektricitetit dhe të elektrizimit të trupave. 	cop	15	10.00	150.00
34	Spektroskop	Dimensione: 11x4x3 cm Përdorimi: Model për shfaqjen e spektrit të parë dhe të dytë të ngjyrave. Është bërë prej plastike. 	cop	5	45.00	225.00
35	Model për shndërrimin e energjisë	Dimensione: 19.5x12x9 cm Përdorimi: Model për demonstrimin e shndërrimit të energjisë nga një lloj në tjetrin. Është bërë prej plastike dhe alumini 	cop	5	40.00	200.00



36	Demonstrues i rregullit të Lencit	Dimensione: 18x7x11 cm Përshkrimi: Model për demonstrim praktik të rregullit të Lencit. Është bërë prej plastike dhe alumini.		cop	5	25.00	125.00
37	Makina e Vims'herstit	Dimensione: 30x15x25 cm Përshkrimi: Model për kryerjen e eksperimenteve në elektrostatiqë; gjeneron tension të lartë dhe rrymë të ulët. Është bërë prej plastike dhe druri.		cop	5	80.00	400.00
38	Kafazi i Faradeit	Dimensione: 48 cm, diametri i kafazit 21 cm Përshkrimi: Është bërë prej një rrjete prej materiali përçues, vendosur në një bazë metallike të hollë e të izoluar		cop	5	45.00	225.00
39	Ndërprerës (celës) i njëfishtë	Dimensione: 9x4x3 cm Përshkrimi: Model i ndërprerësit të njëfishtë. Është bërë prej plastike dhe metali.		cop	5	15.00	75.00


40	Ndërprerës (celës) i dyfishtë	Dimensione: 11x4x4 cm Përshkrimi: Model i ndërprerësit të dyfishtë. Është bërë prej plastike dhe metali. 	cop	5	13.00	65.00
41	Pompë dore për vakum dhe presion	Dimensione: 40x3x10 cm Përshkrimi: Model për fryrje dhe shfryrje. Është bërë prej plastike. 	cop	5	35.00	175.00
42	Zile elektrike	Dimensione: 9x6x27 cm Përshkrimi: Model për tregimin e parimit të punës së ziles elektrike. Është bërë prej plastike dhe metali 	cop	5	42.00	210.00
43	Bobina primare dhe sekondare	Dimensione: 7x7x11 cm Përshkrimi: Bobinat shërbejnë për zmadhim dhe zvogëlim të tensionit 	cop	5	28.00	140.00
44	Pistoletë balistike	Dimensione: 15x15x14 cm Përshkrimi: Është bërë prej plastike dhe metali. Është vendosur në një bazament 	cop	5	45.00	225.00
45	Demonstrues i Ligjit të Arkimit	Dimensione: 24x19x10 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e Ligjit të Arkimit. Është bërë prej plastike. 	cop	5	40.00	200.00

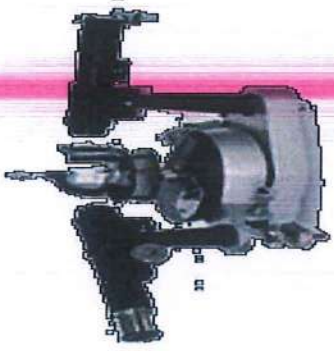
46	Anemometër	Dimensione: 40x22x3 cm Përshkrimi: Model për përcaktimin e drejtitit dhe intensitetit të erës. Është bërë prej metali dhe druri		cop	5	42.00	210.00
47	Lupë	Dimensione: gjatësia 11 cm, diametri Φ 5 cm Përshkrimi: Lupë dore e përbërë nga një qelq zmadhues, kornizë dhe dorezë të bëra prej plastike.		cop	5	8.00	40.00
48	Pasqyrë konkave	Dimensione: 30x4x3 cm Përshkrimi: Model për eksperimente në optikë. Është bërë prej plastike. Është vendosur në një bazament		cop	5	15.00	75.00
49	Pasqyrë konvekse	Dimensione: gjatësia 20x12 cm, diametri Φ 10,5 cm Përshkrimi: Model për eksperimente në optikë. Është bërë prej plastike. Është vendosur në një bazament		cop	5	15.00	75.00

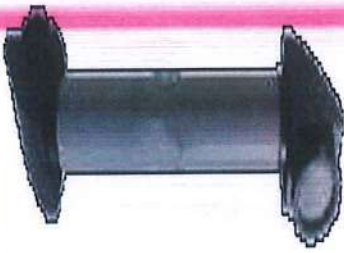
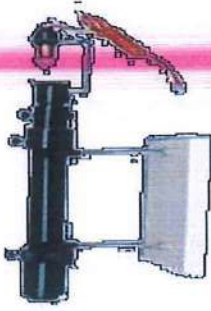
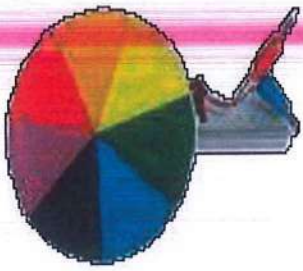
50	Set pasqyrash	Dimensione: Diametër Φ 50 mm, distanca e fokusimit $\pm$ - 10 cm Përshkrimi: Set i përbërë nga një pasqyrë konvekse, një pasqyrë konkave, një pasqyrë e sheshtë, një pasqyrë bikonvekse, një bikonkave dhe një prizëm. Janë vendosur në mbajtëse. Janë bërë prej plastike.				cop	5	45.00	225.00
----	---------------	---	---	--	--	-----	---	-------	--------


51	Set prizmach	Përshkrimi: Set i përbërë nga 10 prizma të ndryshëm: dy prizma bikonveks me dimensione 60x15x15 mm/60x30x15mm; dy prizma bikonkav me dimensione 60x15x10 mm/60x30x10 mm; një prizëm trekëndor me dimensione 55x55x20 mm; një prizëm drejtkëndor me dimensione 55x35x20 mm; një prizëm trapezoid me dimensione 90x35x15 mm; një prizëm konik me dimensione: gjatësi 50 mm dhe ϕ 20 mm; një prizëm cilindrik me dimensione: gjatësi 50 mm dhe ϕ 30 mm; një prizëm trekëndor me dimensione 150x20x25 mm.		cop	5	78.00	390.00
52	Prizëm me mbështetëse	Dimensione: 100x300 mm Përshkrimi: Prizëm qelqi vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	5	38.00	190.00



53	Rrafsh i pjerrët	Dimensione: 95x20x58 cm Përshkrimi: Model për përcaktimin e fërkimit të trupave. Është bërë prej druri dhe metali		cop	5	75.00	375.00
54	Barometër aneroid	Dimensione: 30x4x3 cm Përshkrimi: Model për matjen e shtypjes atmosferike. Është bërë prej plastike.		cop	5	80.00	400.00
55	Model hidroprese	Dimensione: 30x13x30 cm Përshkrimi: Model i hidropresës, për demonstrim të punës së hidropresës. Është bërë prej plastike		cop	5	125.00	625.00
56	Set për elektrostatikë (komplet përcjellësish	Përshkrimi: Model për eksperimente në elektrostatikë, e tregon elektrizimin e materialeve të ndryshme, përbëhet nga shufra prej materialeve të ndryshme		cop	5	75.00	375.00
57	Set spiralesh	Përshkrimi: Set prej pesë spiralesh prej 0,5N, 1N, 2N, 3N, 5N.		cop	5	25.00	125.00

58	Demonstrues për tension sipërfaqësor të lëngjeve	Përshkrimi: Set prej 5 formash të ndryshme për demonstrimin e tensionit sipërfaqësor të lëngjeve		cop	5	23.00	115.00
59	Makinë centrifugimi	Dimensione: Lartësia e modelit 29 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e krijimit të forcës centrifugale gjatë rrotullimit të shpejtë. Baza, doreza dhe pjesa rrotulluese janë prej metali. Në pjesën rrotulluese m		cop	5	78.00	390.00
60	Set makarash	Përshkrimi: Set i përbërë prej dy makarash njëshe, dy dyshe dhe dy treshe. Janë mbështjellë rreth një plastike me kushinetë në një baze të hollë dhe me çengelë për t'u fiksuar në majë dhe në fund.		cop	5	25.00	125.00

61	Gurë peshoreje me çengel	Përshkrimi: Set prej 9 gurësh peshoreje me një çengel me peshë 10 g – 1000g si vijon: 1 gur prej 10 g, dy gurë prej 20 g, një gur prej 50 g, një gur prej 100 g, dy gurë prej 200 g, një gur prej 500 g dhe një gur prej 1000 g. Janë paketuar në një kuti plastike me fole për secilin gur. 	cop	5	80.00	400.00
62	Gurë peshoreje me dy çengellë	Përshkrimi: Set prej 10 gurësh peshoreje me dy çengellë me peshë prej 50 g për çdo gur. Janë paketuar në një kuti plastike me fole për secilin gur. 	cop	5	25.00	125.00
63	Spektrometër	Përshkrimi: Spektrometri përbëhet nga një kolimator përçues, një platformë rrotulluese teleskopi, sistem optik akromatik 26 mm, sistem optik për zmadhim 10 herë, si dhe një prizëm i sheshtë me dimensione 25x25 mm. Është paketuar në kuti. 	cop	5	158.00	790.00

64	Periskop	Dimensione: diametër 3 cm, gjatësi 20,5 cm Përshkrimi: Pajisje optike e cila përbëhet nga një tub në skajet e të cilit ka pasqyra të fiksuara të cilat janë të pjerrëta në drejtim me boshtin e tubit në kënd prej 450 dhe mund të rrotullohen. Është bërë prej plastike.		cop	5	38.00	190.00
65	Model për difraksionin e dritës	Përshkrimi: Pajisje për difraksion dhe polarizim të dritës. Me këtë model tregohet përthyerja e dritës nga drejtimi i përhapjes së saj drejtvizore		cop	5	58.00	290.00
66	Disku i Njutonit	Përshkrimi: Model i demonstrimit të përzierjes së ngjyrave. Disk me diametër 140 mm që vihet në lëvizje me një mikro motor me fuqi minimumi 4 V dhe me minimumi 1.000 rrotullime në minutë. Është vendosur në një mbajtëse plastike. Është bërë prej plastike.		cop	5	25.00	125.00

67	Kalorimetër	Dimensione: 10x11 cm Përshkrimi: Kalorimetri përdoret për matjen e nxehtësisë së reaksioneve kimike ose të ndryshimeve fizike si dhe të		cop	5	22.00	110.00
68	Kabulo për lidhje 35 cm	Gjatësia: 35 cm Përshkrimi: Kabulo për lidhjen e qarqeve elektrike		cop	30	4.00	120.00
69	Kabulo për lidhje 50 cm	Gjatësia: 50 cm Përshkrimi: Kabulo për lidhjen e qarqeve elektrike.		cop	30	4.00	120.00
70	Postera	Postera te ndryshem nga Fizika : Dimensione: 100x70 cm Përshkrimi: Imazh arsimor i shypur me ngjyra në letër 150 g/m2, me plastifikim të dyanshëm, e përforcuar me listela plastike.		cop	60	13.00	780.00
71	Peshore	"Peshore elektronike, dixhitale 300 g/10 mg me mbajtëse nga inox me kabulo energjie me peshë 200g*1"		cop	10	45.00	450.00


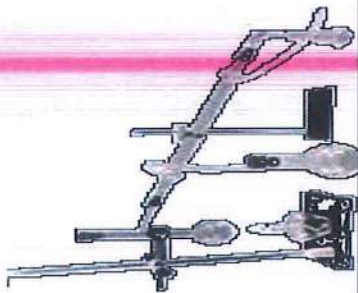
72	Peshore	"Peshore elektronike, dixhitale 2000 g/1g pa pesha"		cop	10	48.00	480.00
73	Motor me naftë	Dimensione: 17x12x28 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e parimit të punës të motorit me naftë. Është bërë prej metali dhe plastike.		cop	5	60.00	300.00
74	Motor me benzinë	Dimensione: 17x12x28 cm Përshkrimi: Model shërben për demonstrimin e parimit të punës të motorit me benzinë.		cop	5	60.00	300.00
TOTALI							19,124.50
SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E KIMISË							
Nr.	Përshkrimi	Specifikimi teknik	Foto	Njësia matëse	Sasia	Çmimi per njesi	Çmimi total me TVSH
1	Epruveta	Dimensionet: L16; F1.6 cm ; 16x160mm Përshkrimi: Të ndërtuara nga qelqi i kualitetit të lartë.Me dim.16x160		Copë	40	4.50	180.00
2	Pipetë	Dimensionet: L48; F1.5 cm Përshkrimi: Përdoret për vendosje precize të lëngut voluminoz. Volumi maksimal deri në 10ml. Të ndërtuara nga qelqi i cilësisë së lartë.		Copë	40	9.00	360.00



3	Buretë	Dimensione: L 75; Φ 2 cm Përshkrimi: Tub i shënuar prej qelqi me tapë në fund, në të cilin është shënuar shkallëzimi prej 100 ml.		Copë	10	42.00	420.00
4	Enë komunikuese	Dimensione: 17x17x10 cm Përshkrimi: Aparaturë e përbërë prej 4 enësh komunikuese, të bëra prej qelqi.		Copë	15	33.00	495.00
5	Hinka	Dimensionet: L14; F8 cm Përshkrimi: Përdoret për vendosje precize të lëngut në ndonjë proces. E ndërtuar nga qelqi me kualitet të lart.		Copë	15	18.00	270.00
6	Llambë alkooli	Dimensione: L 10; Φ 8 cm Përshkrimi: Llambë alkooli, është bërë prej qelqi.		Copë	10	28.00	280.00
7	Xham sahati	Dimensione: Φ 8 cm Përshkrimi: Xham sahati, për përzierje të substancave gjatë reaksioneve		Copë	10	12.00	120.00
8	Ena e Petri-t	Dimensione: Φ 9 cm Përshkrimi: Është bërë prej plastike		Copë	10	15.00	150.00

9	Erlenmajer (250)	Dimensionet: L13; F9 cm Përshkrimi: Shërben për lëng kur kryhen reaksione dhe përgatiten tretje. Ka shenja për volum nga 100, 150, 200 dhe 250 ml		Copë	15	20.00	300.00
10	Gotë (250ml)	Dimensionet: L9; F7.5 cm Përshkrimi: Shërben për lëng dhe për afërsisht e tregon volumin. Përmban: shenja për volum nga 100,150,200 dhe 250ml 150, 200 i 250 ml		Copë	15	24.00	360.00
11	Gotë trekëndëshe (250 ml)	Dimensione: L 9; Φ 7,5 cm Përshkrimi: Është bërë prej qelqi me cilësi të lartë, ku është shënuar shkalla prej 250 ml.		Copë	15	22.50	337.50
12	Enë për lëngje	Dimensione: L 26; Φ 13 cm Përshkrimi: Është bërë prej qelqi, me kapacitet 2 l.		Copë	15	20.00	300.00
13	Peshore	Dimensionet: 12x20x8cm; Përshkrimi: Model i peshorës analoge për peshimin e materieve gjatë reaksioneve kimike. Përdoret deri në 10g.		Copë	5	75.00	375.00

14	Cilindër (100 ml)	Dimensionet: L 25; F 3cm Përshkrimi: Përbërë nga qelqi me kualitet të lartë në të cilin është shënuar shkalla nga 0 deri në 100 ml		Copë	15	38.00	570.00
15	Gur peshore	Dimensionet: 13x8x8cm; Përshkrimi: Komplet me shtat gurë Peshë: 10.2 x 20.50, 2x100 dhe 200 gr si dhe një pincetë plastike për zhvendosjen e gurëve të peshave.		Copë	5	58.00	290.00
16	Rafti për epruveta (nga druri me 12 hapje)	Dimensionet: 15x20x7cm; Përshkrimi: E ndërtuar nga druri dhe përdoret për vendosje vertikale të më shumë epruvetave. Ka dy rende me nga 6 hapje për epruvetra		Copë	10	25.00	250.00
17	Mbajtëse epruvetash – plastike (me 6 hapje)	Dimensione: 10x16x6 cm Përshkrimi: Mbajtëse për epruvetra, është bërë prej plastike. Ka një radhë me 6 hapje.		Copë	10	23.00	230.00

18	Rafti për eproveta (nga alumini me 30 hapje)	Dimensionet: 8x28x9cm; Përshkrimi: E ndërtuar nga alumini dhe përdoret për vendosje vertikale të më shumë epruvetave. Ka tre rënde me nga 10 hapje për epruveta.		Copë	10	32.00	320.00
19	Lug për lënd kimike (e metalitë)	Dimensionet: L 20cm; Përshkrimi: E ndërtuar nga metali, rezistuese ndaj lëndëve kimike		Copë	20	8.00	160.00
20	Lugë për kimikate (plastike)	Dimensionet: L16 cm Përshkrimi: Lugë për kimikate, është bërë prej plastike, është rezistente ndaj kimikateve.		Copë	20	4.00	80.00
21	Kapse për epruveta	Dimensionet: 18x3x1cm; Përshkrimi: E ndërtuar nga druri, dhe shërben për mbajtjen e epruvetave.		Copë	20	9.00	180.00
22	Model 3D i atomit	Dimensione: Lartësia 43 cm, diametri 30 cm Përshkrimi: Model atomi në 3D, ku mund të shihen bërthama e atomit dhe mbështjella elektronike, si dhe grmëcat më të vogla: protonet, neutronet dhe elektronet. Është bërë prej plastike		Copë	5	85.00	425.00

23	Kuti me minerale	Dimensione: 19x12x3 cm Përshkrimi: Koleksion me 20 lloje të ndryshme mineralesh. Janë paketuar në një kuti mbrojtëse		Copë	5	78.00	390.00
24	Aparat për elektrolizë	Dimensione: 19x10 cm Përshkrimi: Aparat i përbërë nga një tub qelqi, i zgjeruar në pjesën e sipërme, dy tuba qelqi, në të cilët është shënuar shkalëzim deri në 30 ml, Aparati punon në 12 V.		Copë	5	225.00	1125.00
25	Model i molekulës	Dimensionet: 30x23x4cm; Përshkrimi: Shërben për njohje vizuale të strukturës së molekulës		Copë	5	117.00	585.00
26	Distilues uji	Dimensione: 45x18x10 cm Përshkrimi: Set i përbërë nga: llamba me alkool me dimensione 13x10 cm, kondensator Liebig me gjatësi 20 cm, elemaer prej 250 ml, poçe për distilim të fraksionuar prej 500 ml, dhe një poçe për distilatin prej 250 ml		Copë	5	175.00	875.00

27	Aparati i Hofmanit për elektrolizë	Përshkrimi: Aparat për elektrolizë në ujë. Përbëhet nga tri tuba prej qelqi. Cilindri i brendshëm është i hapur në majë për të shtuar ujë dhe komponentë jonik për përmirësim të përcueshmërisë. 	Copë	5	213.00	1065.00
28	Set laboratorik	Dimensionet: 33x44x9cm; Përshkrimi: seti përbëhet nga: epruveta, rafti, pipeta, hinka, elemaeri dhe tapa 	Copë	5	73.00	365.00
29	Mbajtëse e enëve kimike për eksperimente	Dimensione: 50x21 cm Përshkrimi: Mbajtëse me katër mbajtëse të tjera më të vogla për enë laboratorike, e bërë prej metali, vendosur në një bazament prej plastike ose prej materiali ekuivalent. 	Copë	5	58.70	293.50
30	Aparati i Kipit 250 ml	Përshkrimi: Aparati i Kipit është një lloj qeramike komplekse laboratorike e cila shërben për prodhim të kontrolluar të sasive të vogla të gazit, më shpesh të hidrogjenit dhe të dyoksidit të karbonit. 	Copë	5	178.00	890.00

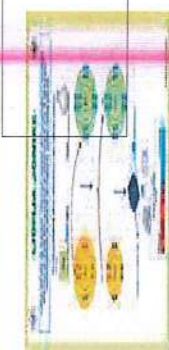
31	Havan dhe shtypës	Dimensione: Dijametër: 100mm, kapacitet 130 ml Përshkrimi: Havan dhe shtypës të bërë prej porcelani.		Copë	10	18.00	180.00
32	Trekëmbësh metalik	Dimensione: 18x13 cm Përshkrimi: Trekëmbësh metalik i cili përdoret për eksperimente në lëndën e kimië		Copë	10	17.50	175.00
33	Pipetë pikuese	Dimensionet: L 11; Përshkrimi: përbëhet për lëng kur kryhen reaksione dhe përgatiten tretje. Ka shenja të volumit nga 10, 15, 200 dhe 25ml		Copë	15	10.00	150.00
34	Lakmues i kuq	Përshkrimi: Lakmues me ngjyrë të kuqe, për të treguar alkalitetin e tretësirave. Tretësirat alkaline e ngjyrosin letër lakmuesin me ngjyrë blu. Kuti me 100 fletë me gjatësi 50 mm dhe gjerësi 7mm.		Copë	20	9.00	180.00

35	Lakmues blu	Përshkrimi: Lakmues me ngjyrë blu, për të treguar aciditetin e tretësirave. Tretësirat acide e ngjyrosin letër lakmuesin me ngjyrë të kuqe. Kuti me 100 fletë me gjatësi 50 mm dhe gjerësi 7mm.		Copë	20	9.00	180.00
36	Lakmues pH	Përshkrimi: Lakmues pH për përcaktimin e vlerave të pH të tretësirave. Kuti me 100 fletë me gjatësi 50 mm dhe gjerësi 7mm		Copë	20	9.00	180.00
37		Termometer laboratorik -10C deri 50C		copë	15	15.00	225.00
38		Termometer laboratorik -10C deri 110C		copë	15	17.00	255.00
39		Termometer laboratorik -10C deri 200C		copë	15	19.00	285.00

40	Filtër prej letre	Përshkrimi: Letër për filtrim, paketuar në kuti – 100 fletë. Dimensione: diametër 125 mm.		Copë	15	12.50	187.50
41	Tapa (kapak) me 1 apo 2 hapje	Përshkrimi: Të ndërtuara nga goma me kualitet të lartë.		set	15	10.00	150.00
42	Shpuese tapash	Përshkrimi: Set prej 15 shpuesesh për tapa, me madhësi të ndryshme të cilat përdoren për të hapur vrima në tapa.		Copë	10	23.00	230.00
43	Brushë për epruveta	Dimensione: L 20; F 2cm Përshkrimi: Shërben për larje të brendshme të epruvetave		Copë	15	6.00	90.00
44	Furçë për epruveta Dimensione: 240x120x25	Përshkrimi: Furçë për epruveta, për larje të brendshme të epruvetave, me dimensione 240x120x25		Copë	15	4.00	60.00
45	Furçë për epruveta Dimensione: 280x140x30	Përshkrimi: Furçë për epruveta, për larje të brendshme të epruvetave, me dimensione 280x140x30 mm.		Copë	15	3.00	45.00

46	Rrjet azbesti	Përkirimi: Përdoret për ngrohjen e objekteve për shpërndarje të njetrajtshme të ngrohtësisë në bazën e objekteve.		Copë	15	6.00	90.00
47	Shirit magnezi	Shirit magnezi		copë	15	45.00	675.00
48		Ph meter dore		cop	5	75.00	375.00
49		Etanol		liter	20	15.00	300.00
50		Perkosid hidrogjeni		cop	20	14.00	280.00
51		Acid acetik		liter	20	18.00	360.00
52		Hidroksid amoni		liter	20	13.00	260.00
53		Acid fosforik		liter	20	24.00	480.00
54		Fenol		liter	20	22.00	440.00
55		Klerofon		liter	15	35.00	525.00
56		Acid benzoik		liter	15	24.00	360.00
57		Glukozë		liter	20	40.00	800.00
58		Formalin		liter	20	25.00	500.00
59		Uji klorig		liter	20	25.00	500.00
60		ACID SULFURIK		liter	20	48.00	960.00
61		ACETON		liter	20	28.00	560.00
62		KALIUM PERMANGANAT		100ml	20	25.00	500.00
63		SULFAT ALUMINI		100ml	20	22.00	440.00
64		BENZENE		100ml	20	48.00	960.00
65		NATRIUM METAL		gr	12	118.00	1416.00
66		Klorur amoni		0.5kg	12	25.00	300.00
67		Acetan natriumi		0.5kg	12	27.00	324.00
68				0.250kg	12	25.00	300.00
69		Oksid mangani (piroluzit)		0.250kg	15	22.00	330.00
		Sulfat Zinku					

70		Sulfat Hekuri		0.250kg	15	22.50	337.50
71		Oksid Zinku		0.250gr	15	22.50	337.50
72		Hidroksid bakri		0.250gr	10	180.00	1800.00
73		Fehling 1 dhe 2 (100ml)		cop	10	118.00	1180.00
74		DIETIL – ETER		liter	10	135.00	1350.00
75		ACID KLORHIDRIK		liter	10	32.00	320.00
76		Mantela te bardha per laborator		copë	90	20.00	1800.00
77		Syza mbrojtse		copë	40	12.00	480.00
78	Sistemi periodik i elementeve (poster)	Dimensione: 120x80 cm Përshkrimi: Poster i është i plastifikuar, i përforcuar me listela plastike		Copë	30	15.00	450.00

79	Postera per Zoologji 100x70 cm	Dimensione: 100x70 cm Përshkrimi: Poster i është i plastifikuar në të dyja anët, i përforcuar me listela plastike.		Copë	40	15.00	600.00
80	Postera per Kimi 100x70 cm	Dimensione: 100x70 cm Përshkrimi: Poster i është i plastifikuar në të dyja anët, i përforcuar me listela plastike.		Copë	40	15.00	600.00

SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E GJEOGRAFISË					TOTALI	35,903.50
Nr	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi per njesi	Çmimi total me TVSH	
1	Kosova hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
2	Kosova hartë rrugore 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
3	KOSOVA-Harta Relief 3D dim.112x90cm	Copë	50	35.00	1750.00	
4	Shqipëria hartë fiziko gjeografike / politike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
5	Shqipëria hartë rrugore 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
6	Gadishulli Ballkanik harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
7	Gadishulli Ballkanik harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
8	Evropa harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
9	Evropa harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
10	Afrika harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
11	Afrika harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
12	Azia harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
13	Azia harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
14	Amerika Veriore harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
15	Amerika Veriore harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
16	Amerika Jugore harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
17	Amerika Jugore harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	
18	Australia harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00	

19	Australia harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
20	Bota harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
21	Antarktida hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
22	Arktiku hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
23	Evropa Perëndimore hartë fiziko 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
24	Evropa Lindore hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
25	Evropa Jugore hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
26	Evropa Qendrore hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
27	Gadishulli Apenin hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
28	Gadishulli Pirinej hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
29	Forma dhe madhësia e tokës 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
30	Hartografi 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
31	Sistemi i yjeve dhe sistemi diellor 140 x 100cm	Copë	50	26.40	1320.00
32	Glob F30 në gjuhën shqipe	Copë	50	26.40	1320.00
33	Glob F30 induktiv	Copë	50	26.40	1320.00
34	Modeli Tokë -diell-hënë	Copë	50	26.40	1320.00
35	Kurbometer	Copë	50	26.40	1320.00
36	Busulla F5	Copë	50	10.00	500.00
37	Busulla F10	Copë	50	12.00	600.00
38	Busull metalike	Copë	50	18.00	900.00
39	Tensioni i punës: 2.4-3V	Copë	50	15.00	750.00
40	Teleskop	Copë	50	35.00	1750.00
41	Atlas gjeografik me CD	Copë	50	8.00	400.00
42	KOSOVA Hartë shkollore fiziko - gjeografike	Copë	50	1.50	75.00
43	Shqipëria Hartë shkollore fiziko - gjeografike	Copë	50	1.50	75.00
44	Evropa Hartë shkollore fiziko - gjeografike	Copë	50	1.50	75.00
45	Bota Hartë shkollore fiziko - gjeografike	Copë	50	1.50	75.00
46	Harta Memece Kosova	Copë	50	1.50	75.00
47	Harta Memece Evropa	Copë	50	1.50	75.00
				Totali	51,980.00
SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E HISTORISË					
Nr.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi per njësi	Çmimi total me TVSH

1	Qytetërimet e para Egjipti i Lashte Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
2	Mesopotamia dhe Asiria Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
3	Trevat Shqiptare (395-1261) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
4	Iliria Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
5	Hellada dhe Ballkani Jugor no kohen klasike Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
6	Lufta Greko - Persiane, Beteja e Termopileve, beteja Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
7	Shtetet e lindjes së vjetër dhe kultura kreto - mikenase Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
8	Pushtimet Romake te Periudhës Republikane (504-44 P.E.S.) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
9	Pushtimet e Romës Nga Augusti Te Trajani Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
10	Dyndja e madhe e popujve (shek. IV-XVII) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
11	Kalifatit arab - Spanja në vitin 750 - Spanja në vitin 1150 - Sp. 1469 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
12	Dyndjet e mëdha te popujve në perandorinë romake Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
13	Perandoria e Karlit Te Madh (768 - 814) Ndarja e Sht.te Fra. 843 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
14	Kryqëzatat Ndarja e Shtetit te Frankeve ne vitin 843 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
15	Zbulimet e mëdha gjeografike (shek. XV - XVII) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
16	Betejat e Skënderbeut me osmanlinjtë (1443-1468) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
17	Principatat Shqiptare në shek. XIV Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
18	Shqiptarët përballj osmanëve (1400-1506) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
19	Shqipëria nga shek. XVI deri në mesin e shek. XVIII Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
20	Pashallëqet e mëdha shqiptare (mesi i shek. XVIII-1831) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
21	Zhvillimi i perandorisë Osmane Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
22	Pushtimet e Napoleon Bonapartit Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
23	Shpërbërja e perandorisë osmane 1800-1923 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
24	Ballkani 1830-1914 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
25	Lëvizjet kombëtare shqiptare vitet 1832 -1881 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
26	Lëvizjet shqiptare (1882 - 1912) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
27	Shqipëria gjatë viteve 1913- 1918 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
28	Shteti Shqiptar dhe viset tjera Shqiptare (1919-1924) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
29	Lufta e parë botërore Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
30	Kosova në kohën e ekspansionit serb (1196-1355)	Copë	50	25.30	1265.00
31	Operacionet luftarake në paqësor (lufta e dytëbotërore) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
32	Opeacionet luftarake në Evropë (lufta e dytë botërore) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
33	Kosova në kufijtë e provincës romake moesia superior Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00

34	Kosova në kohën e ekspansionit serb (1196-1355) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
35	Kosova në sanxhakët e hershëm osmanë në fillim të shek. XVI Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
36	Kosova në kohën e depërtimit të ushtrisë habsburgase Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
37	Kosova gjatë ekspansionit të serbisë dhe malit të zi 1817-1833 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
38	Kosova pas paqes së shën stefanit dhe kongresit të berlinit më 1878 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
39	Lidhja e prizrenit (1878 - 1881) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
40	Kosova në sistemin e vilajeteve osmane rreth vitit 1900 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
41	Kërkesat dhe zgjerimet territoriale pas luftërave ballka. 1912/1913 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
42	Kosova pas vitit 1913 Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
43	Kosova gjatë luftës I botërore Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
44	Ndarja e kosovës në zona në mbretërinë sks (1929-1941) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
45	Kosova gjatë luftës II botërore (1941-1944) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
46	Kosova në jugosllavi (1945-1991) Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
47	Kosova pas vitit 1999 dhe zonat e forcave paqeruajtëse të nato-s. Harte historike dim 140x100cm	Copë	50	25.30	1265.00
				Totali	59,455.00

SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E MATEMATIKËS

Nr.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi per njesi	Çmimi total me TVSH
1	Trekëndësh dybrinjënjëshëm prej druri 45x50 cm kualiteti I larte	Copë	80	18.00	1440.00
2	Trekëndësh me brinjë të ndryshme prej druri 60x60 cm kualiteti I larte	Copë	80	18.00	1440.00
3	Raportor (këndmatës) druri kualiteti I larte	Copë	80	15.00	1200.00
4	Vizore plastik 100cm	Copë	80	13.50	1080.00
5	Kompas druri - Kompas i bërë prej druri. Me gjatësi të krahut deri 50 cm. Kualiteti I larte	Copë	80	20.00	1600.00
6	Kompas plastik - Kompas i bërë prej plastike. Me gjatësi të krahut deri 50 cm.	Copë	80	17.00	1360.00
7	Set trupash gjeometrik prej druri: piramidë, cilindër, kon, sferë, prizëm, kub dhe paralelepipet 1/6 lartësia dhe gjërësia e trupit 150 mm.	set	40	75.00	3000.00

8	Set trupash gjeometrik prej teli: piramidë, cilindër, kon, paralelepiped, sferë, prizëm dhe kub. Janë bërë prej teli me trashësi prej 3 mm me lartësi e gjerësi të trupit prej 150 mm.	set	40	98.00	3920.00
9	Model për relacion kon/cilindër nga plastika. Dim. Lartësia L 10 cm; diametri Φ 10 cm.	Copë	60	57.00	3420.00
10	Model koni me 4 prerje (rreth, elips, hiperbolë, parabolë) me diametër 10 cm dhe lartësi 10 cm.	Copë	60	45.00	2700.00
Totali					21,160.00

SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E INFORMATIKES

Nr.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi per njesi	Çmimi total me TVSH
	Tabelë Smart Diagonal sizeMin 86" Resolution:3840 x 2160				

1	Response time: max. 8 ms Brightness: Min 400 cd/m2 Glass Surface: Technology: Anti-Glare+Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass or better Lifespan: Min. 50.000 hours Touch technology: IR Touch Accuracy: Min 1mm Pens: Min 2 included Touch points: Min. 40 Multimedia File Formats Support Image: JPEG, BMP, PNG Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, etc OPS slot: YES OPS: PC Min. Intel i5, 8GB RAM, 250GB SSD, Windows 10 Pro licence Front Interface Min. USB Type-C 65W x 1, HDMI 2.0 x 1, USB Type-B (Touch) x 1, USB 3.0, Type-A x 1, Mic in x 1 Rear Interface Min. HDMI IN 2.0 x 2, HDMI OUT 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, RJ45 (Gigabit) IN x 1 & OUT x 1, OPS Slot x 1, Audio Line out x 1, Wi-Fi module slot, USB Type-B (Touch) x 1, USB Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, NFC x 1 Wi-Fi Min. Wi-Fi 6 + BT 5.2 Built In computer Min Android 14, 8GB RAM, 64GB storage Built in speakers: Min. 2 x 15W Camera 3840x2160 / 30fps, F2.2±5%, 3.75x digital zoom, CMOS Sensor 4K, Included Microphones Yes, min 8m range Mirroring Any Device to The Board Share option with Windows, iOS, Android app Warranty: 3 year Electric Mobile trolley Included and should be compatible with the Interactive Smart Board Te perfishihet montimi dhe trajnimi i stafit.	Copë	30	1987.00	59610.00
---	---	------	----	---------	----------

2	Portable scanner Colorful colors, highlight individuality 180° wide-angle lens A3 large format shooting LED fill light, arbitrary adjustment of light intensity Accurate text recognition automatic WORDtypesetting Paperless fax technology·One-key E-MAILtechnology Shooting area: A3 (MAX) Total pixels: 13 Mega pixels Lens: CMOS Lens.180°Wide-angle lens. Sensor specification : &1/3incti Resolution: 4192x3104 Power supply: USB Connection way: USB2.0 AGC/AEC/White balance: Automatic/ Manual Software function: Brightness exposure,sharpness, color, saturation, sharpness, grayscale, hue, contrast, white balance, ect N.W./G.W.: 0.9Kg/1.7Kg Open/Close: 270×150×420mm/150×150×220mm Control method: Touch control Warranty time: 3year Have independent research and development of scanning software, with software copyright. Provide a certificate recognized by a national authority.	Copë	20	238.00	4760.00
				Totali	64370.00
Nr.	Rekapitulim i totalit të çmimeve				Shuma totale
1	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E INFERMIERISE				54963.20
2	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E FIZIOTERAPISE				29827.00
3	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E TEKNOLOGJISE USHQIMORE				7593.00
4	SPECIFIKACIONI I INVENTARIT PER KABINETIN E KIMISE				11116.00
5	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E BIOLOGJISE				62085.00
6	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E FIZIKËS				19124.50
7	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E KIMISË				35903.50

8	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E GJEOGRAFISË		51980.00
9	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E HISTORISË		59455.00
10	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E MATEMATIKËS		21160.00
11	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E INFORMATIKES		64370.00
TOTALI ME TVSH :			417,577.20

✓

Komisioni vlerësues:

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*